


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 15:05:15
Durée: 3mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH MOHAMED	
Date de naissance	14/04/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24071715025240642

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

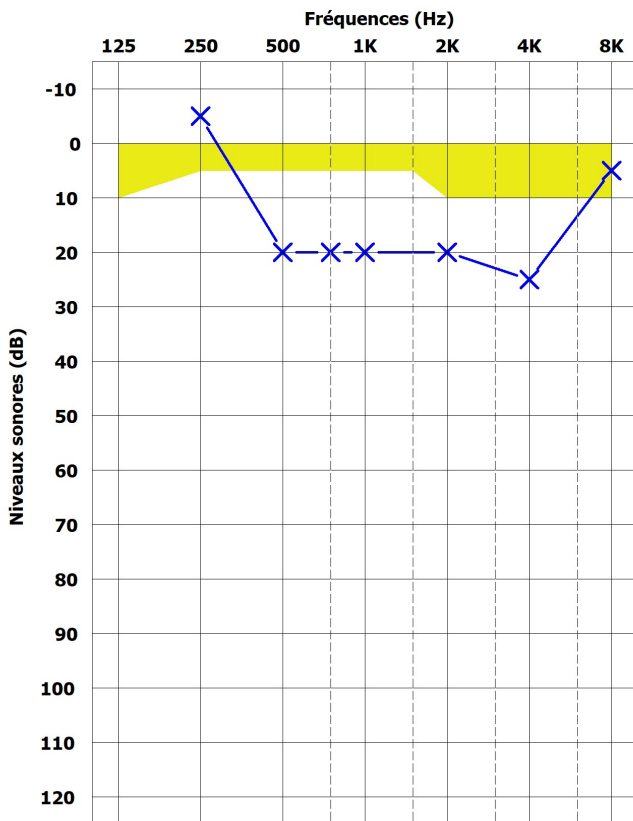

Oreille Gauche

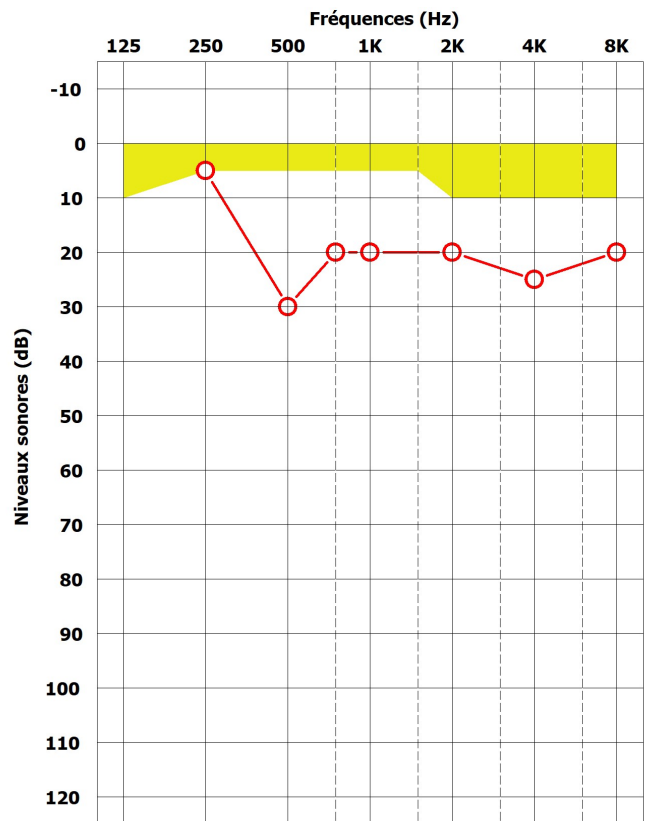

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	20	20	20		20		25		5
CA Droit		5	30	20	20		20		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes