

Données Patient


OULARE ANSOUMANE

Date de naissance 01/01/1989
Age 35
Société CHEC
ID 24112414150435439


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 24/11/2024 14:16:31
Durée: 4mn 56s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

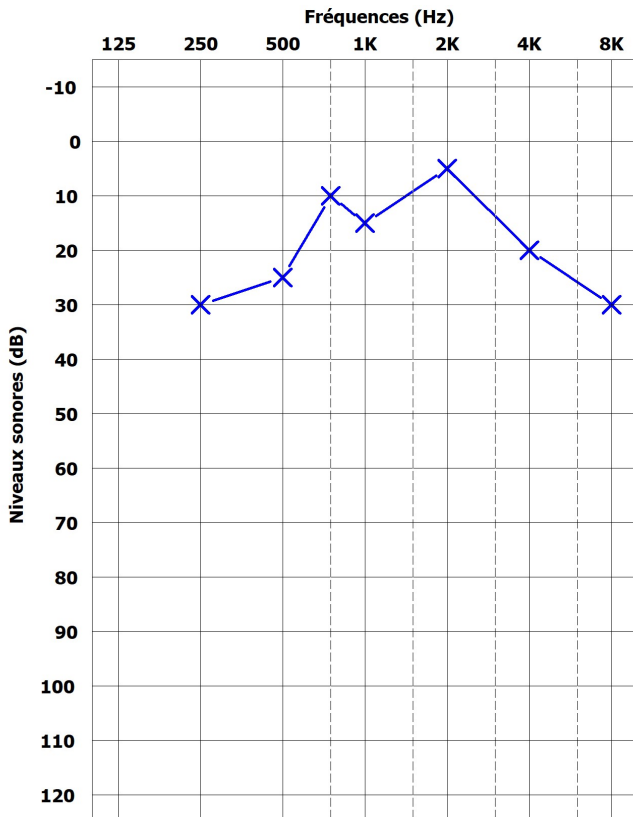

Oreille Gauche

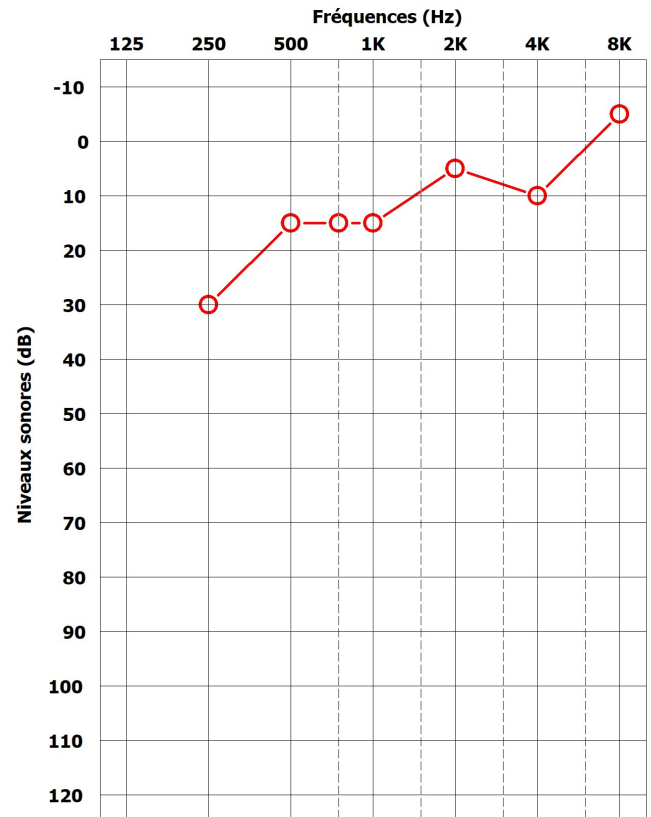

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	10	15		5		20		30
CA Droit		30	15	15	15		5		10		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes