


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 13:58:00
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
Date de naissance	03/03/1984
Age	40
Société	CHEC
ID	24080913563241212

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

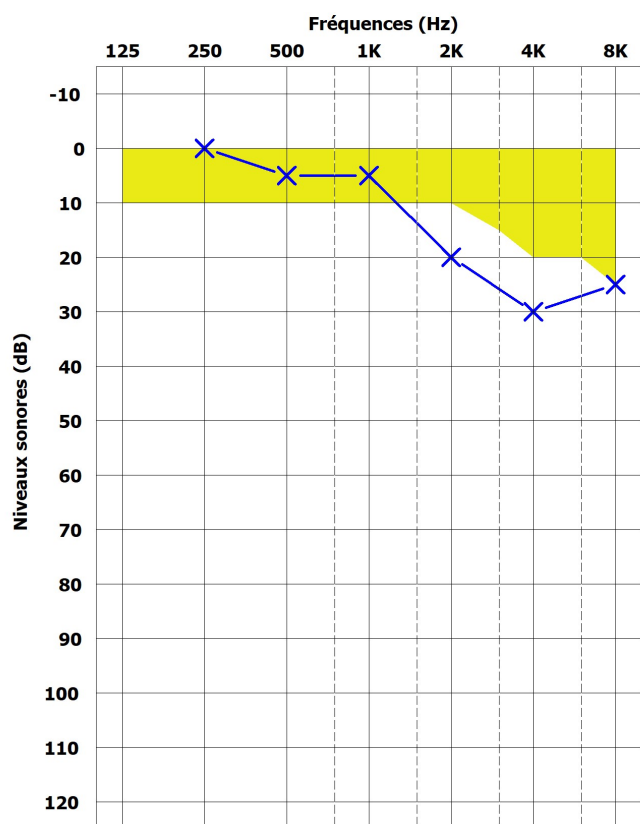

Oreille Gauche

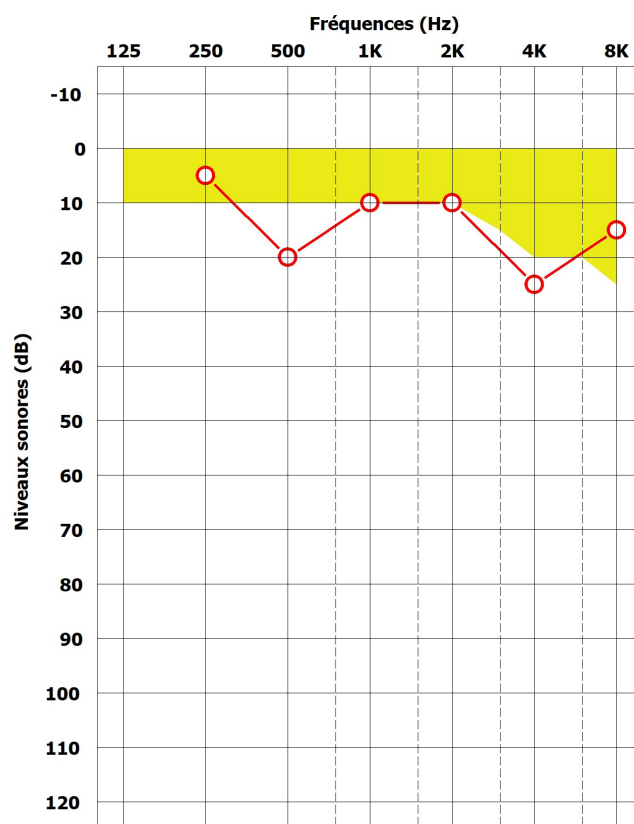

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5		5		20		30		25
CA Droit		5	20		10		10		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes