

MEDVIE


Date du test: 19/06/2024 17:16:42

Durée: 4mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO YERO BAILO
Date de naissance	01/07/1985	
Age	38	
Société	CHEC	
ID	24061917055012551	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

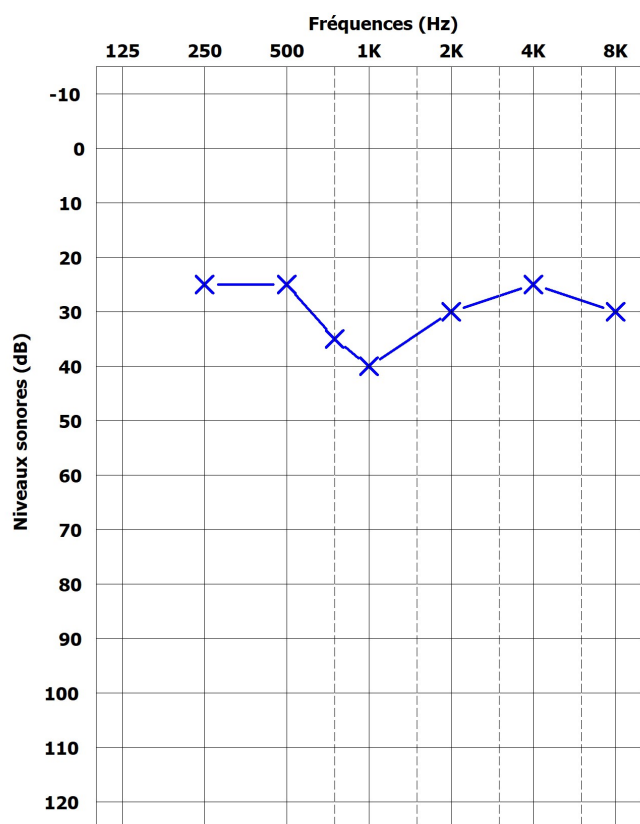

Oreille Gauche

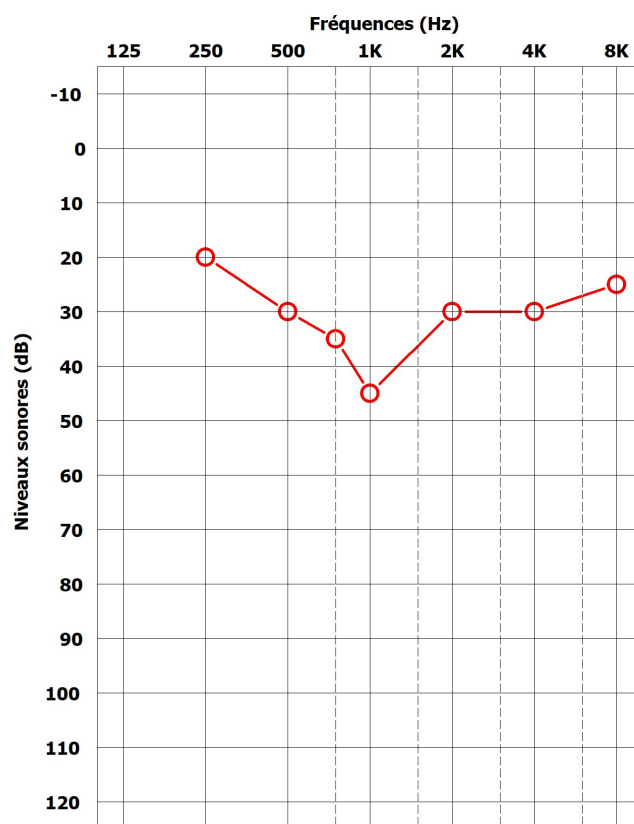

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	35	40		30		25		30
CA Droit		20	30	35	45		30		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes