



Données Patient	
DIAOUNE MAMADOU RHOYE	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CHEC
ID	24092515580756269

Date du test: 25/09/2024 16:00:18
Durée: 3mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

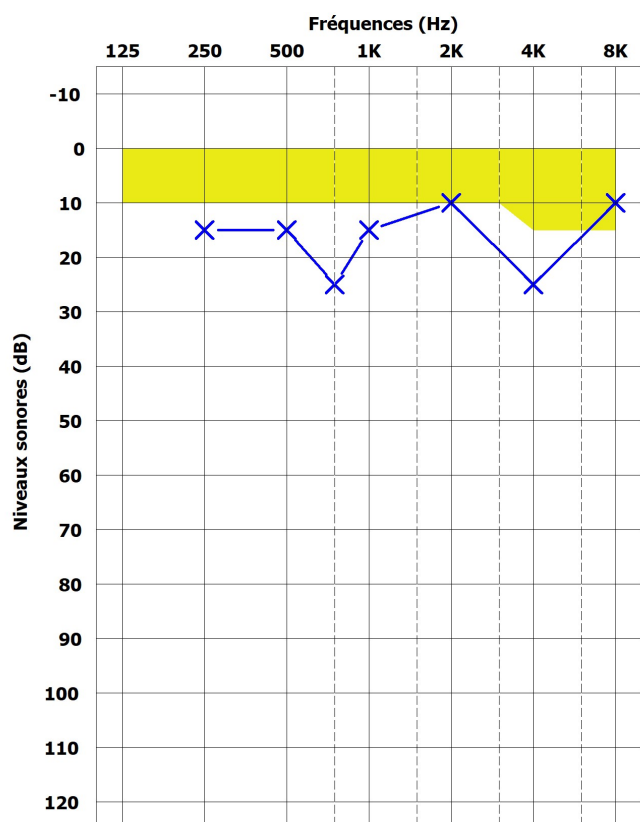

Oreille Gauche

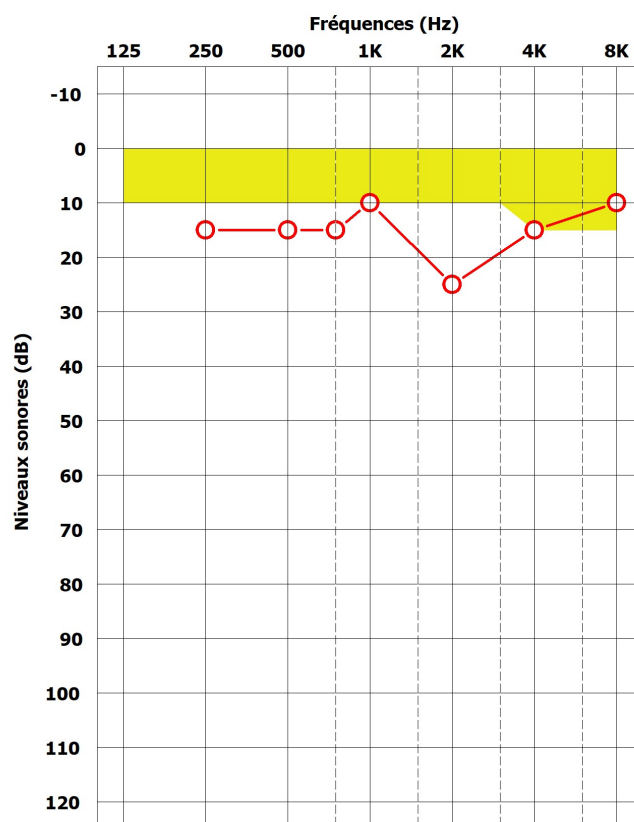

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	25	15		10		25		10
CA Droit		15	15	15	10		25		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes