

MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 15:35:27

Durée: 5mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH MOHAMED	
Date de naissance	02/02/1983
Age	41
Société	CHEC
ID	24083115311221546

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

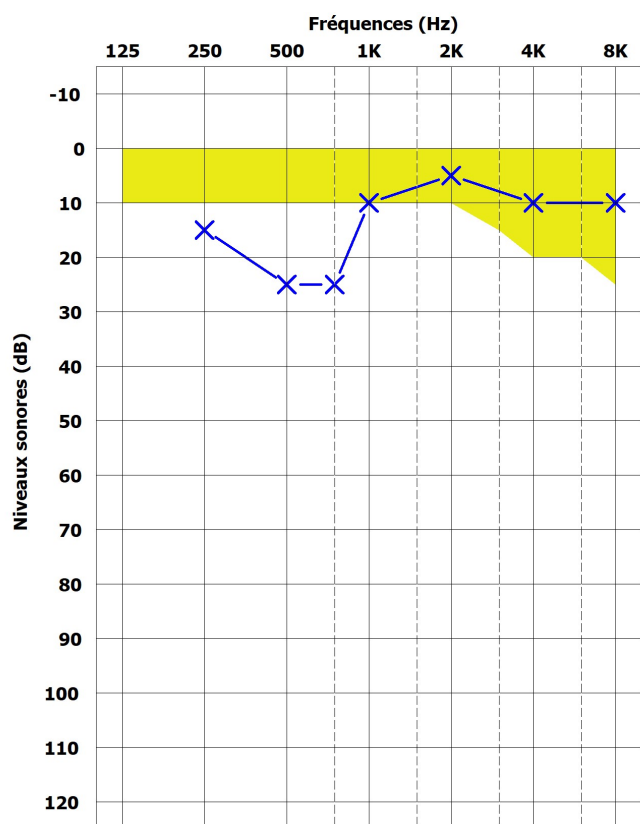

Oreille Gauche

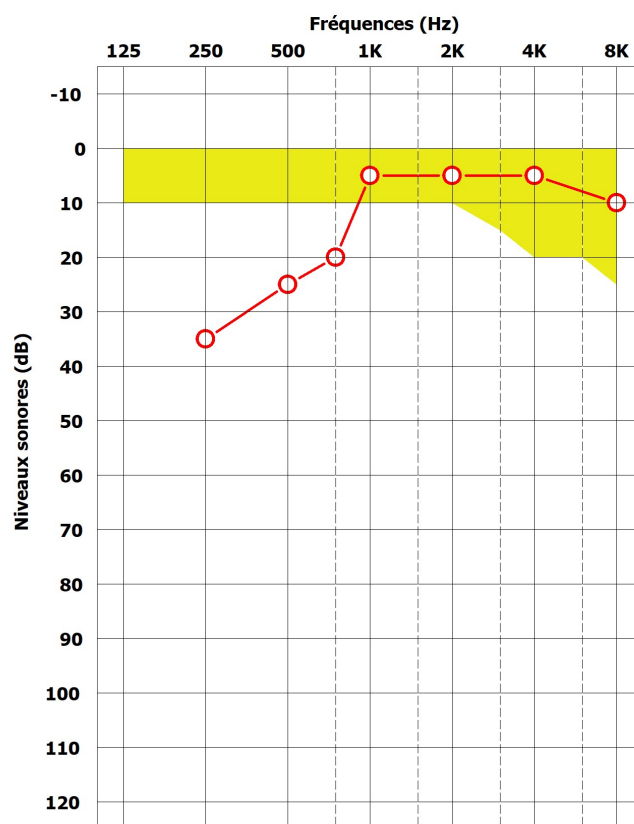

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	10		5		10		10
CA Droit		35	25	20	5		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes