

Données Patient


**PIVI FOROMO**

Date de naissance 01/07/1983  
Age 41  
Société CHEC  
ID 24070615470586571


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211  
Numéro de série: 2111EAT690093  
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/07/2024 15:48:58  
Durée: 4mn 07s  
Type test Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

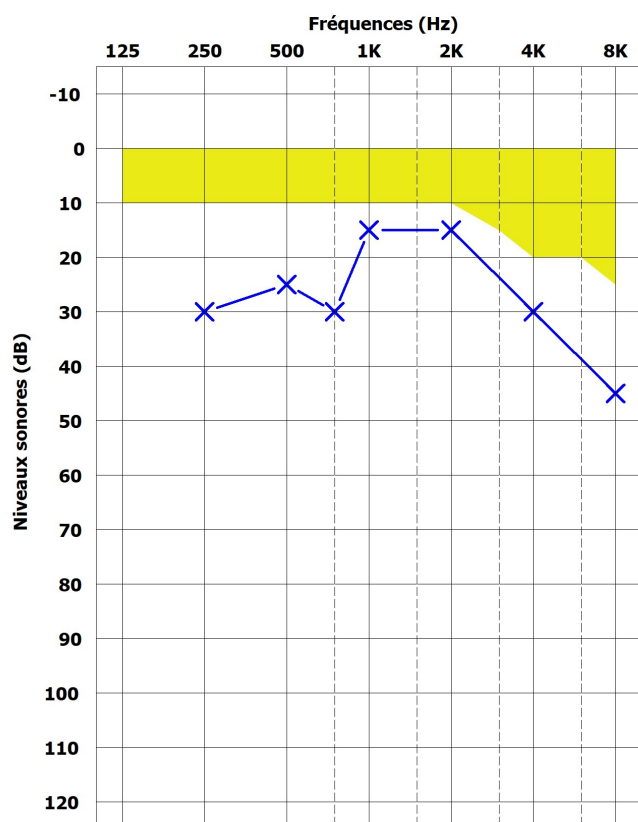

Oreille Gauche

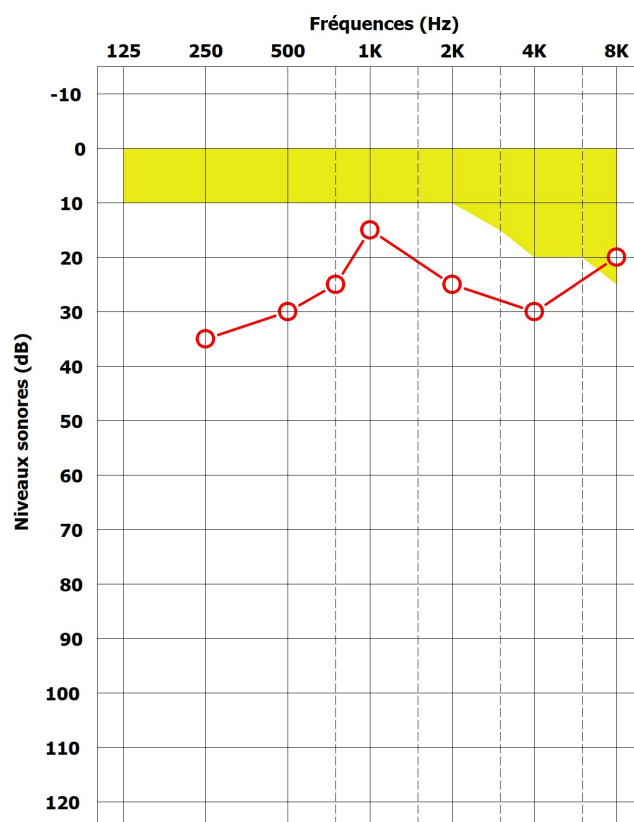

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 25  | 30  | 15 |     | 15 |    | 30 |    | 45 |
| CA Droit  |     | 35  | 30  | 25  | 15 |     | 25 |    | 30 |    | 20 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 21,3 dB | --- |
| CA Droit  | 25,0 dB | --- |

Notes