



Données Patient	
YOULA SEKOU OUMAR	
Date de naissance	26/06/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24083114343600127

Date du test: 31/08/2024 14:37:38
 Durée: -- mn -- s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

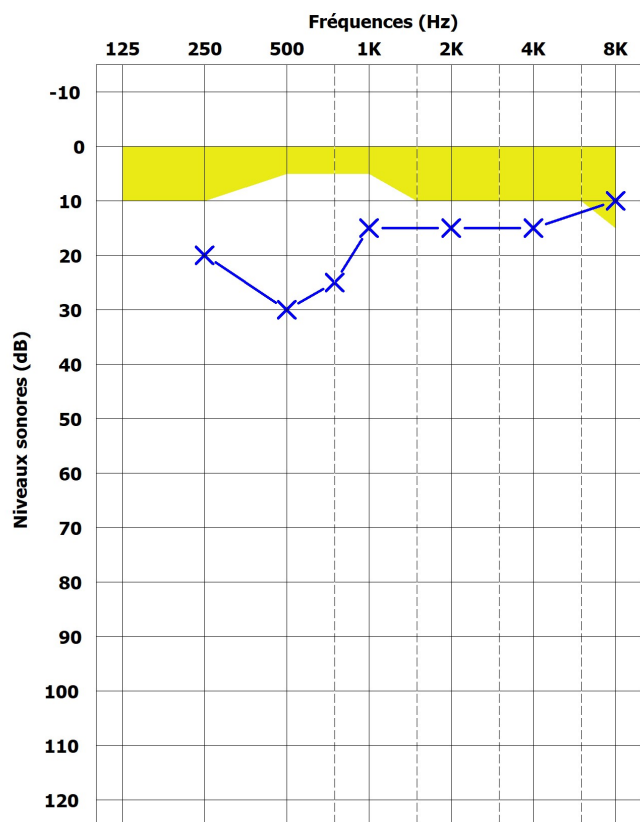

Oreille Gauche

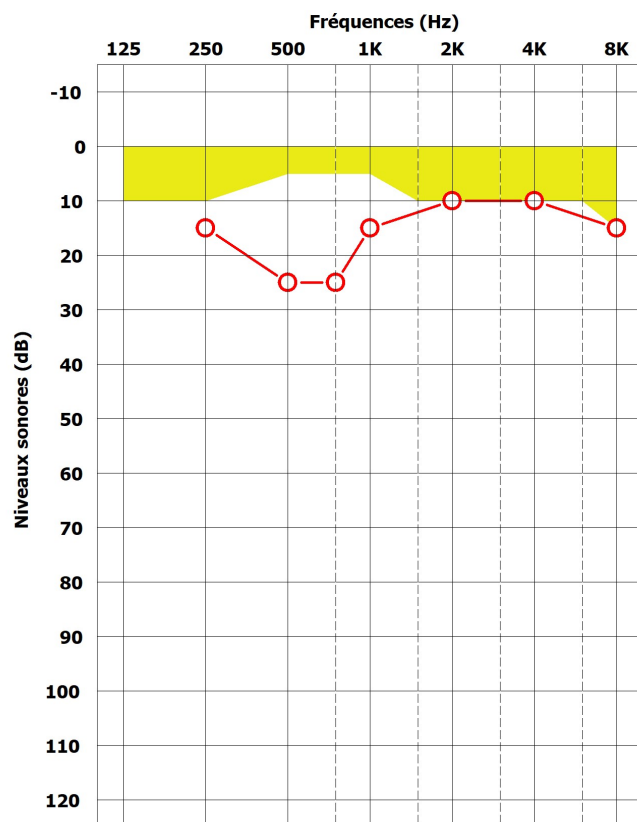

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	15		15		15		10
CA Droit		15	25	25	15		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes