


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 18:35:48

Durée: 4mn 20s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

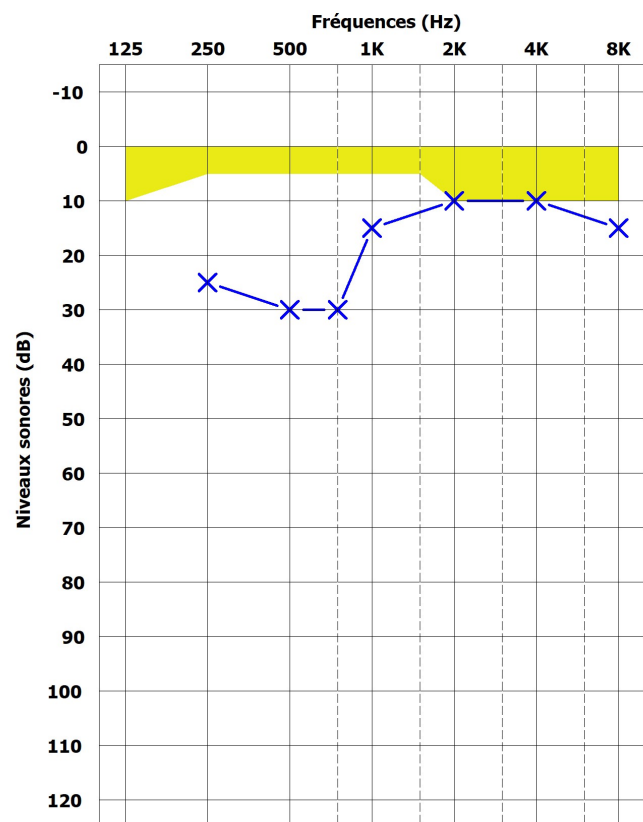

Oreille Gauche

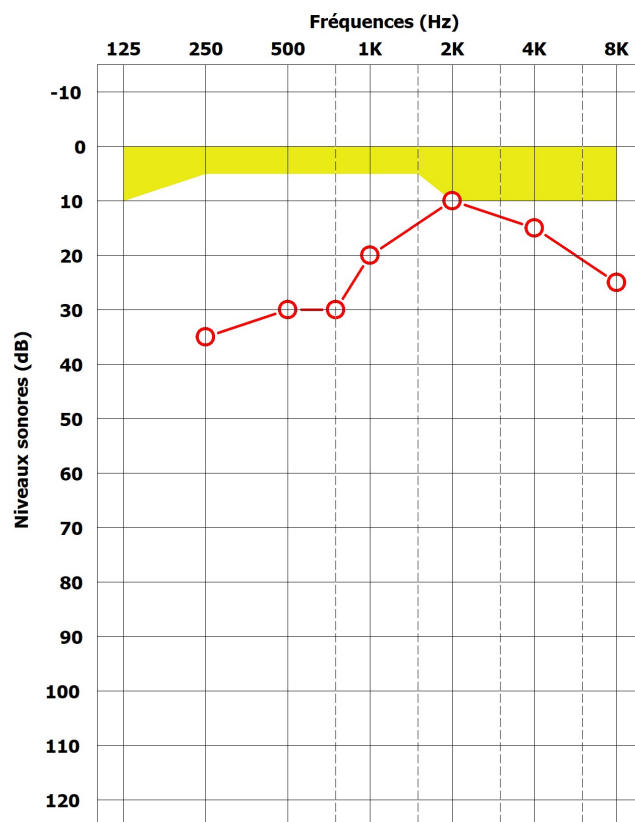

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	15		10		10		15
CA Droit		35	30	30	20		10		15		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH ALMAMY
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24071718335619765

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021