


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 16:04:28
Durée: 2mn 07s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAH FODE	
Date de naissance	02/12/1993
Age	30
Société	CHEC
ID	24081415502034492

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

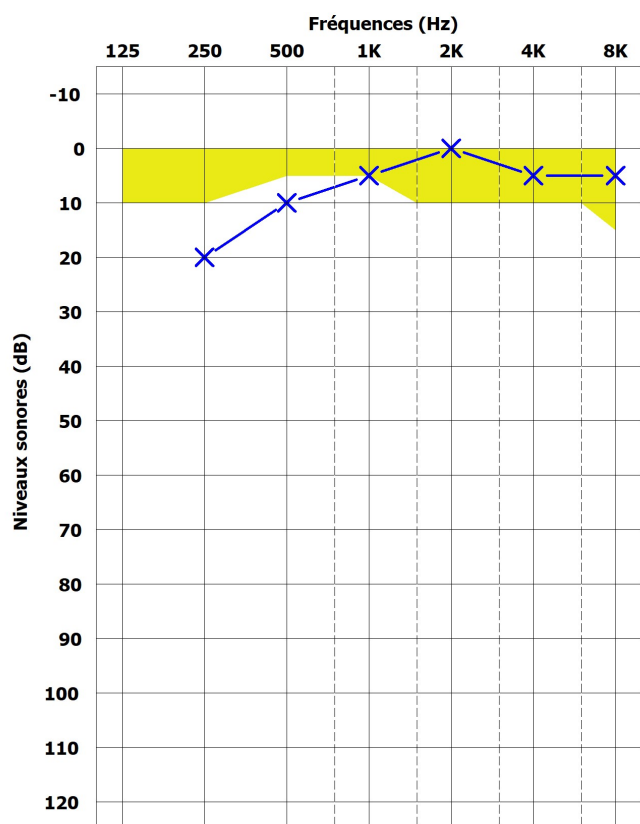

Oreille Gauche

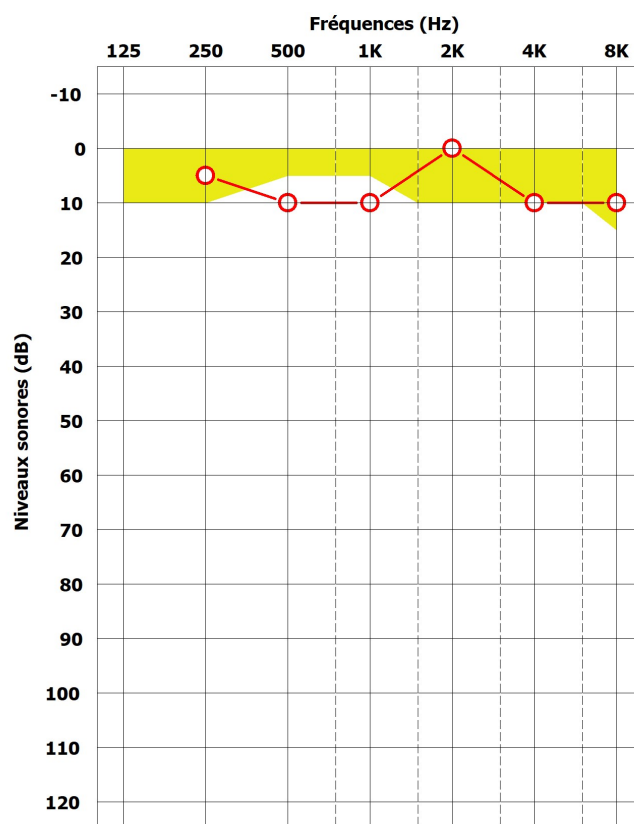

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	10		5		0		5		5
CA Droit		5	10		10		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes