



Données Patient	
MALAMOU MORIBA	
Date de naissance	16/03/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24083115031639391

Date du test: 31/08/2024 15:04:28
Durée: 4mn 12s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

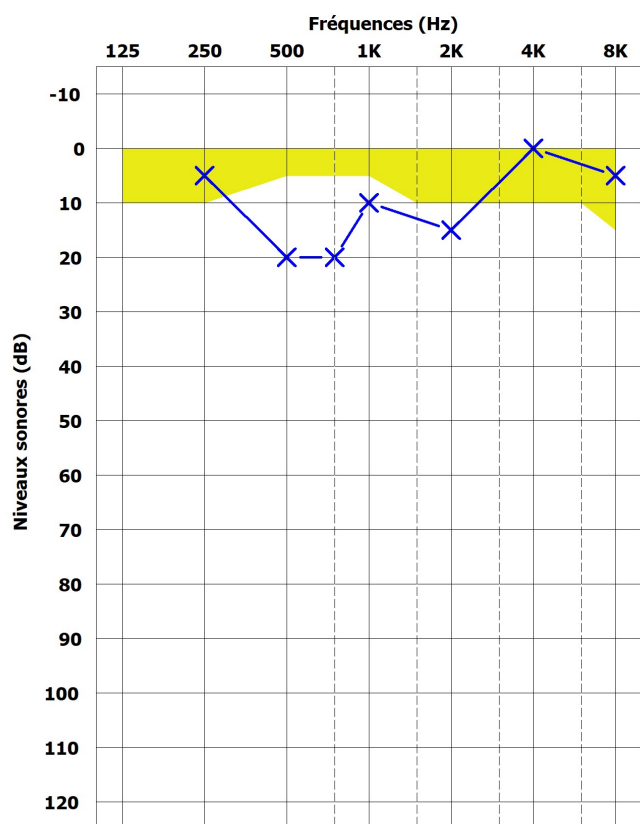

Oreille Gauche

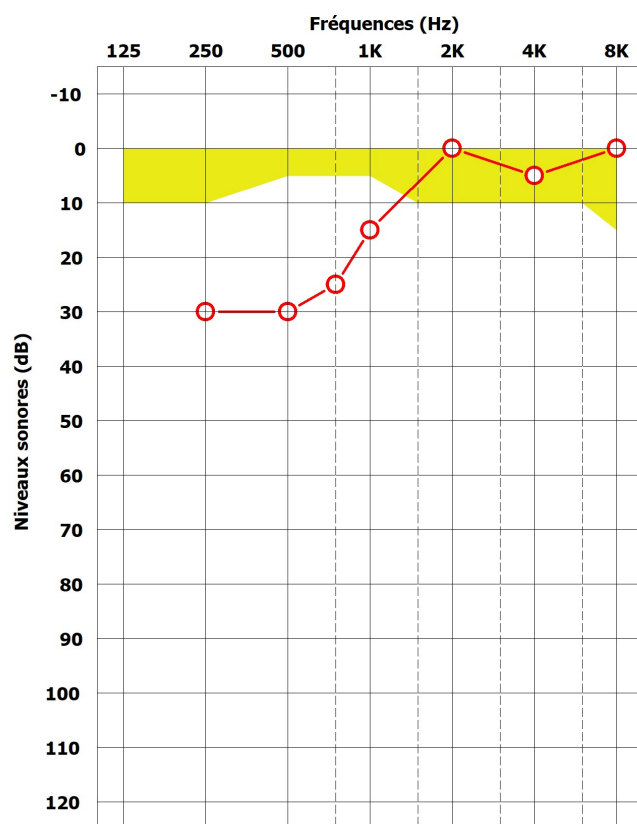

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	20	20	10		15		0		5
CA Droit		30	30	25	15		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes