



Données Patient


SOUMAH OUSMANE

Date de naissance 01/01/1990
Age 34
Société CHEC
ID 24090611522334922


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/09/2024 11:56:34
Durée: 4mn 15s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

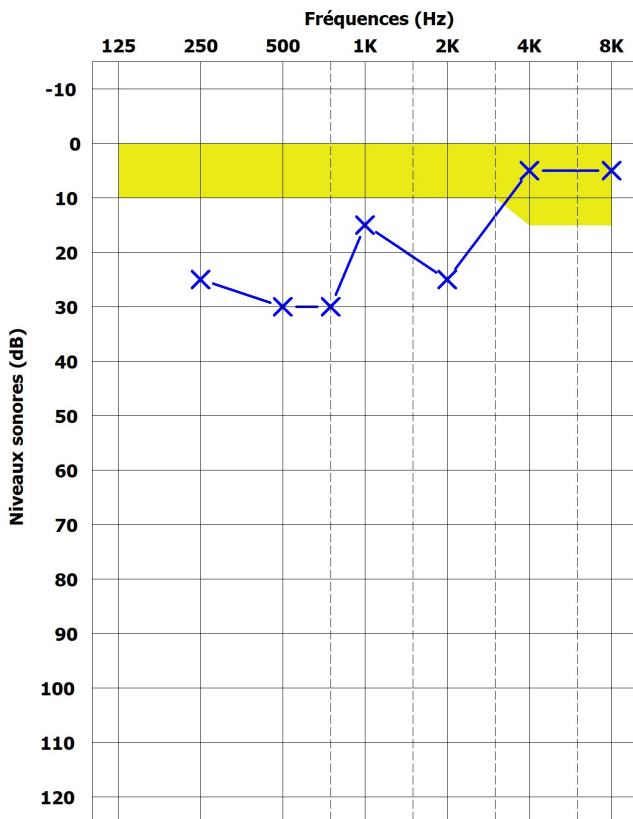

Oreille Gauche

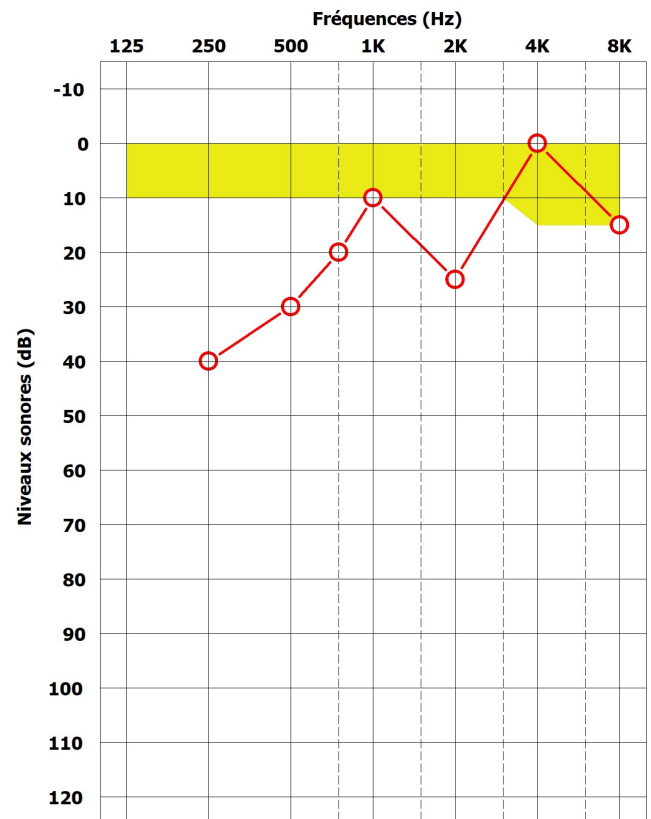

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	15		25		5		5
CA Droit		40	30	20	10		25		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes