

Données Patient


SYLLA OUSMANE

Date de naissance 13/03/1986
Age 38
Société CHEC
ID 24091410204332623


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 14/09/2024 10:28:39
Durée: 4mn 10s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

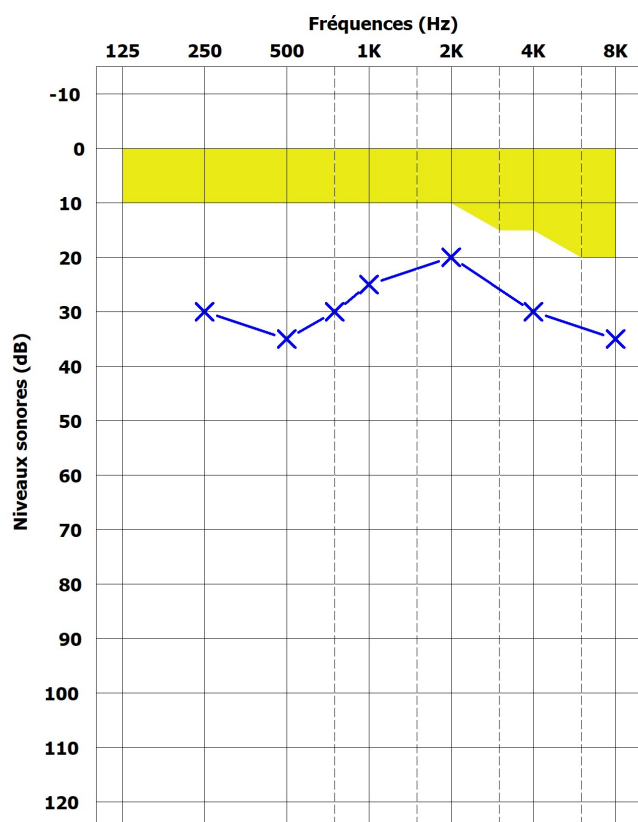

Oreille Gauche

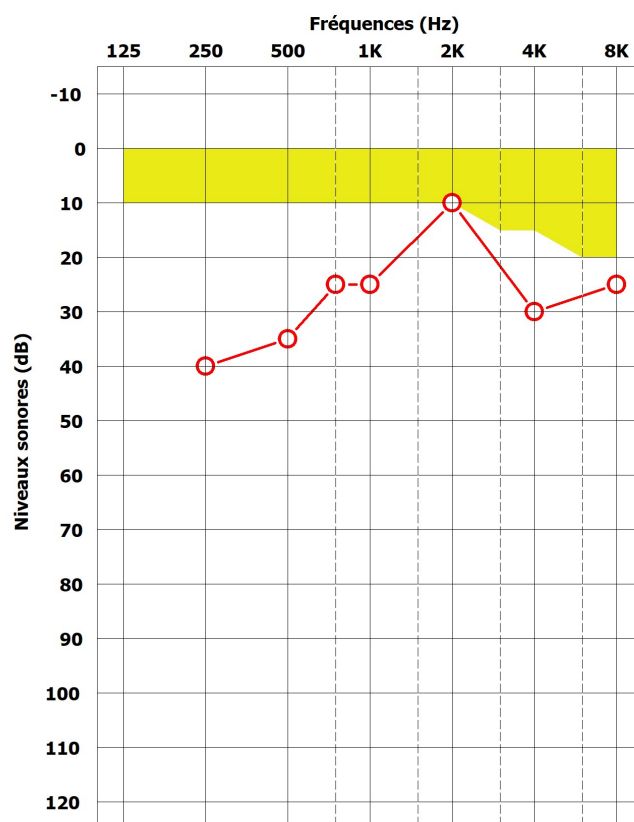

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	25		20		30		35
CA Droit		40	35	25	25		10		30		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes