


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 12:10:23  
Durée: 4mn 20s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | FADIGA MOHAMED    |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 04/10/1986        |
| Age               | 37                |
| Société           | CHEC              |
| ID                | 24072512043162410 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

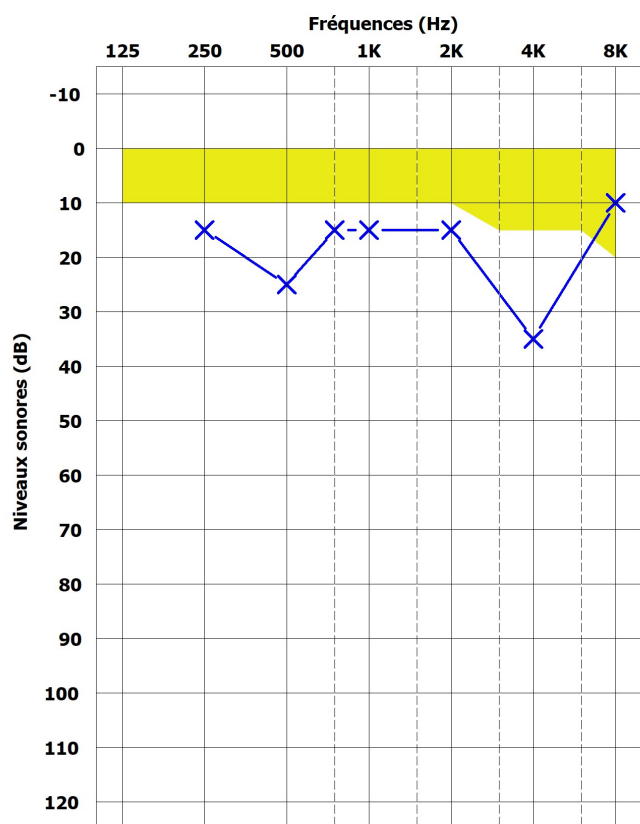

Oreille Gauche

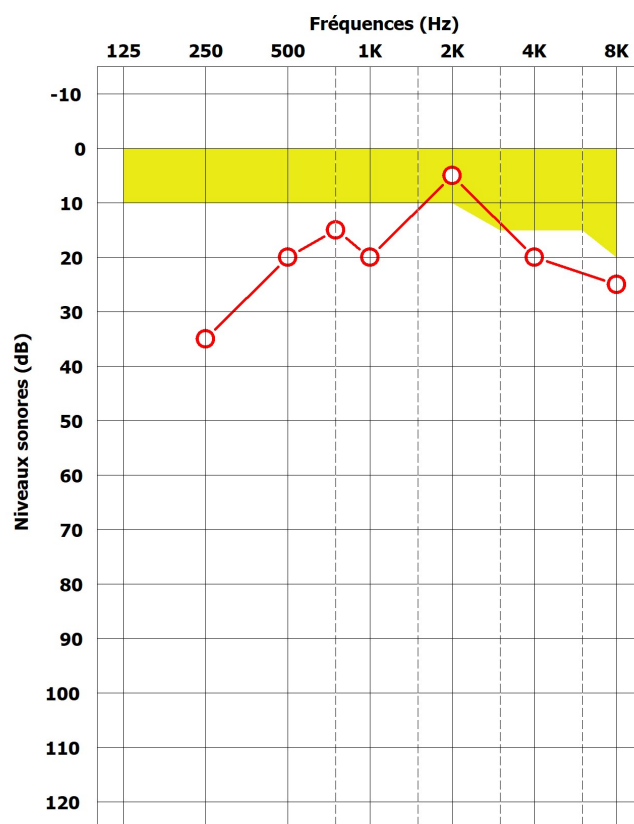

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 15  | 15 |     | 15 |    | 35 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 35  | 20  | 15  | 20 |     | 5  |    | 20 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 22,5 dB | --- |
| CA Droit        | 16,3 dB | --- |

Notes