



Données Patient	SYLLA IBRAHIMA BASSY
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24091114364289052

Date du test: 11/09/2024 14:39:23
 Durée: 3mn 44s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

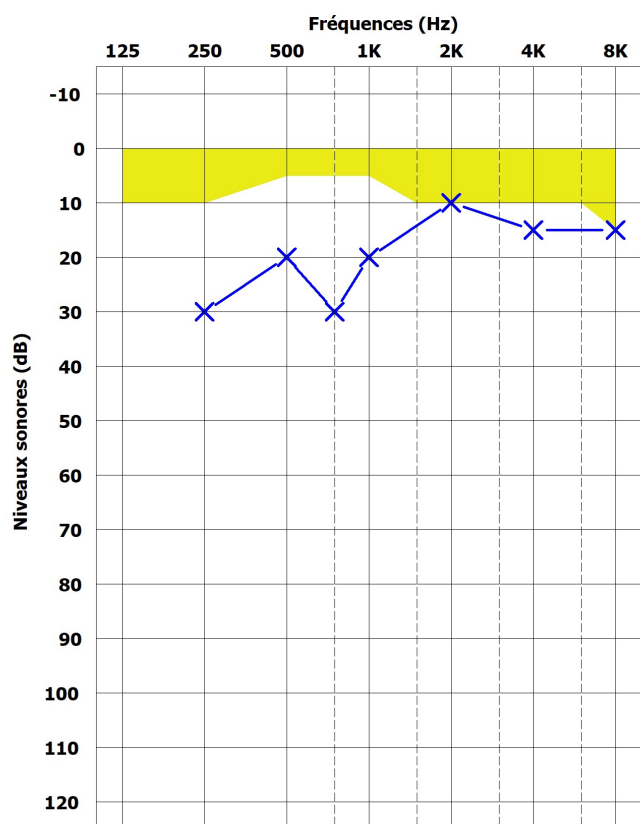

Oreille Gauche

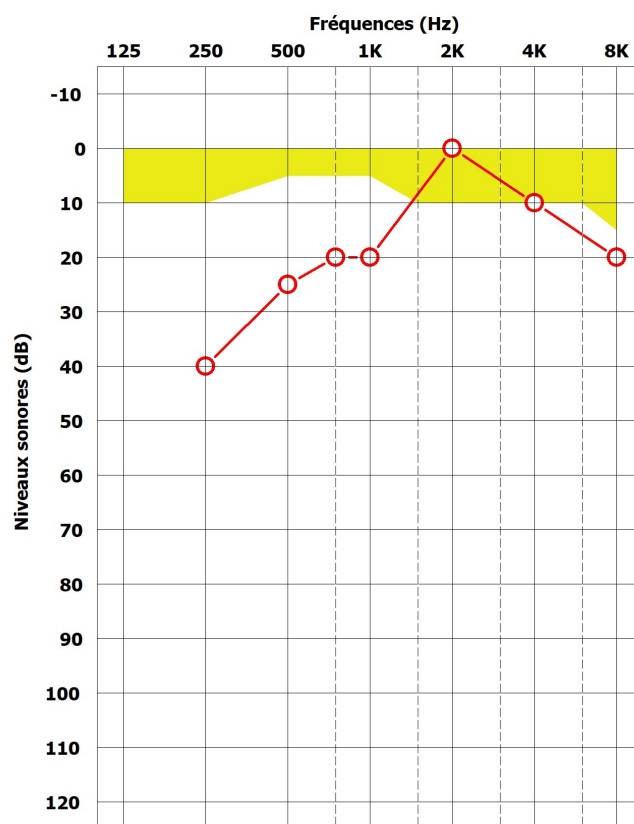

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	30	20		10		15		15
CA Droit		40	25	20	20		0		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes