


MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 17:54:11
Durée: 4mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SACKO OUMAR
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24090617521269804

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

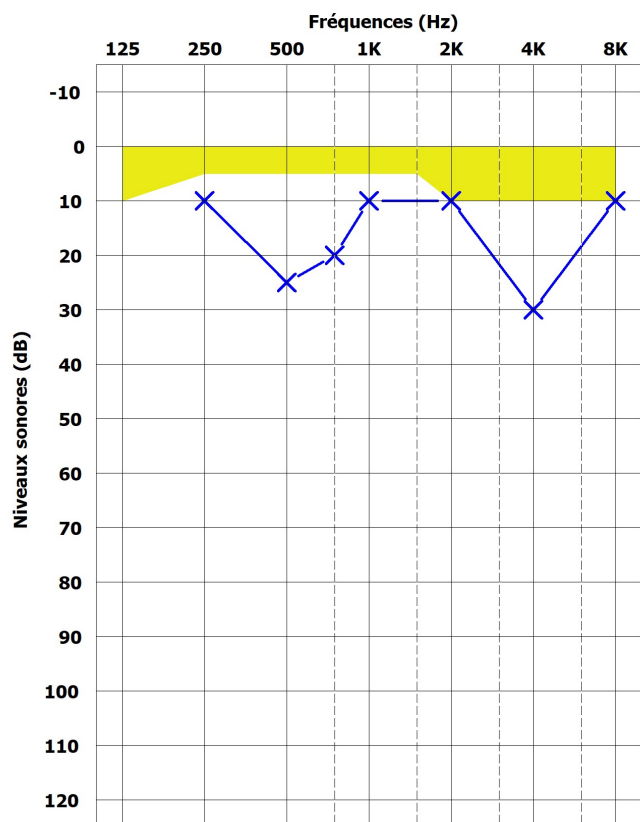

Oreille Gauche

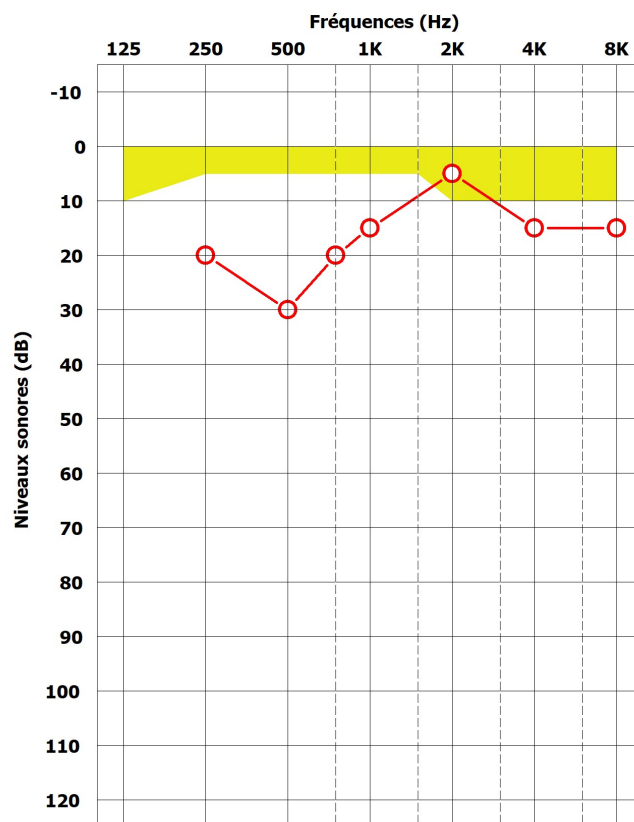

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	10		10		30		10
CA Droit		20	30	20	15		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes