


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 12:57:39
Durée: 5mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	04/06/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24080712472198793

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

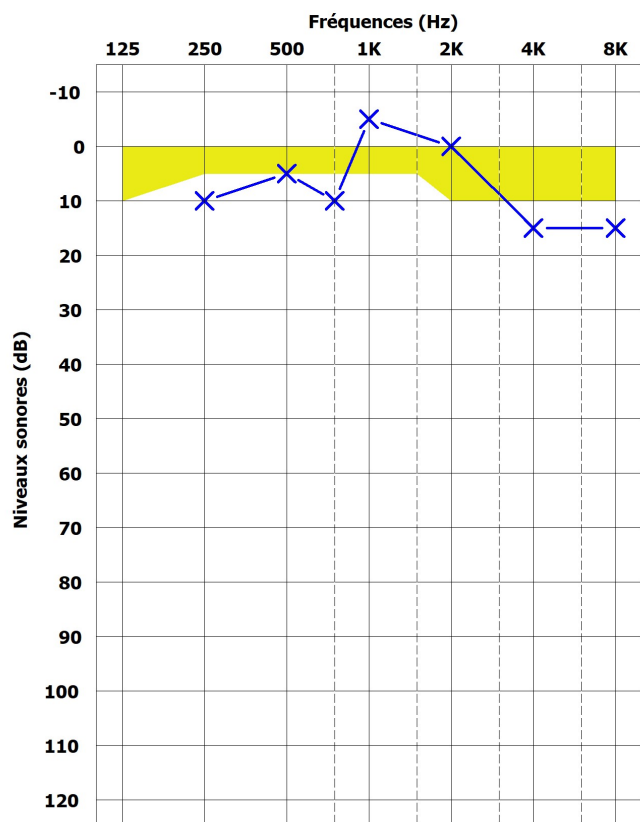

Oreille Gauche

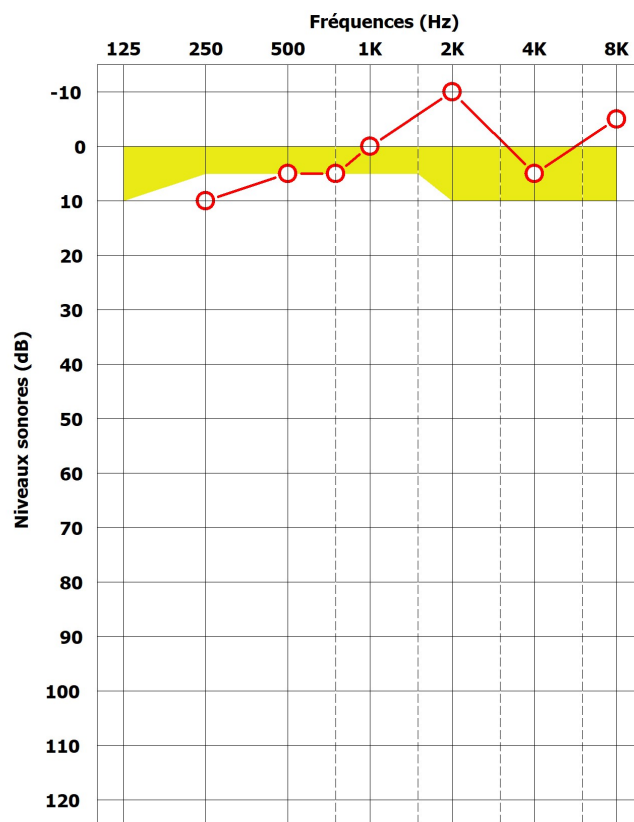

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	10	-5		0		15		15
CA Droit		10	5	5	0		-10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes