

Données Patient

TOURE MOHAMED

Date de naissance 01/01/2001
Age 23
Société CHEC
ID 24070302340380676


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 03/07/2024 02:36:14

Durée: 4mn 46s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

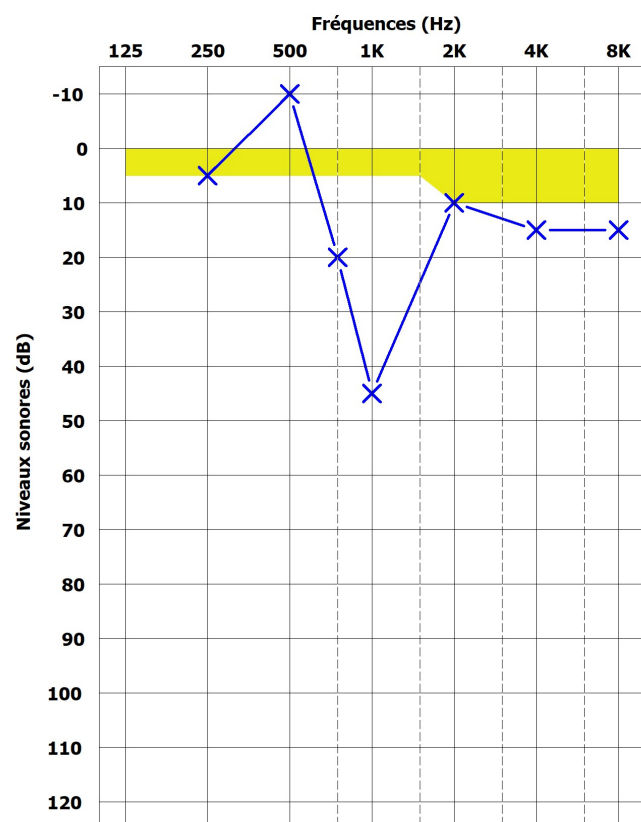

Oreille Gauche

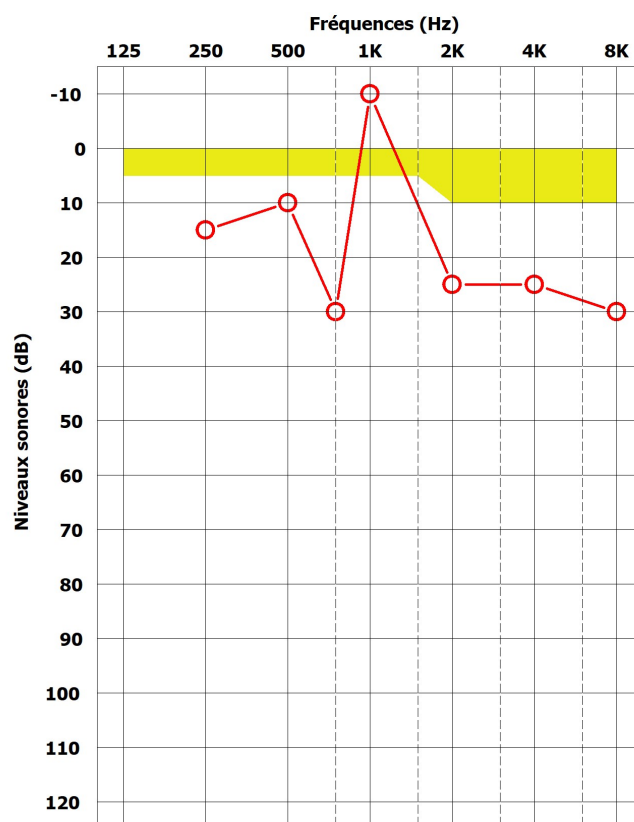

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	-10	20	45		10		15		15
CA Droit		15	10	30	-10		25		25		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes