
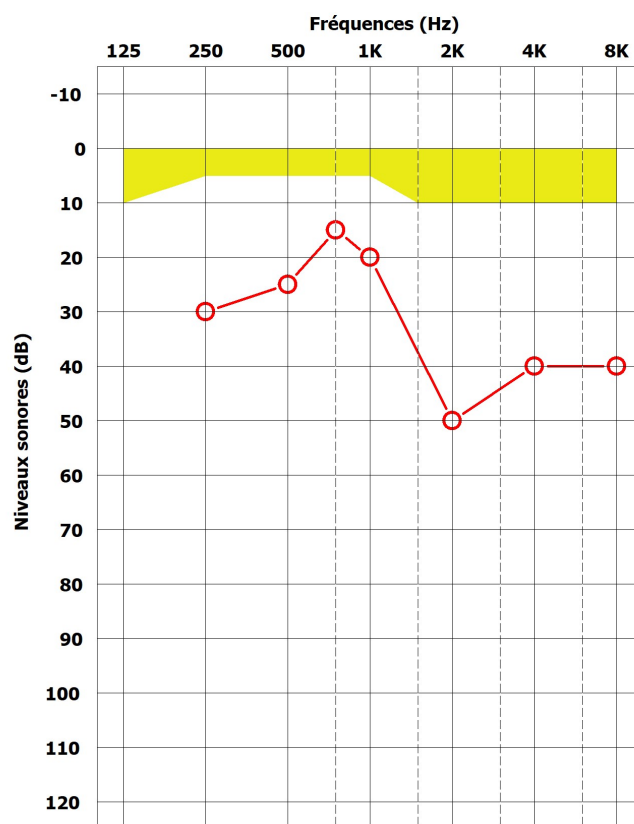


Données Patient		CAMARA OUSMANE
Date de naissance	06/07/1995	
Age	28	
Société	CHEC	
ID	24070521520040324	

Date du test: 05/07/2024 22:02:56
 Durée: 5mn 07s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

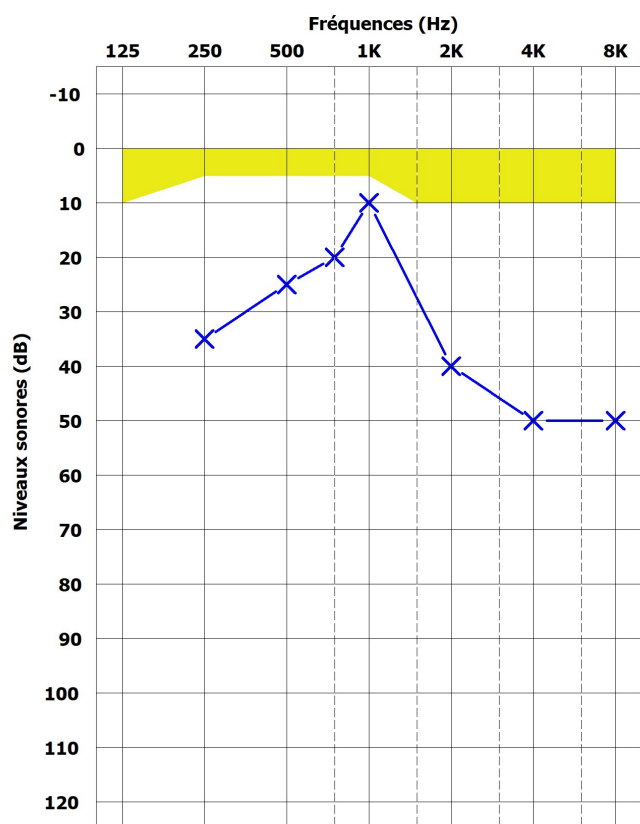

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	20	10		40		50		50
CA Droit		30	25	15	20		50		40		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes