

MEDVIE

Date du test: 15/07/2024 16:20:21

Durée: 4mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA OUMAR

Date de naissance

01/01/1998

Age

26

Société

CHEC

ID

24071516165886233

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

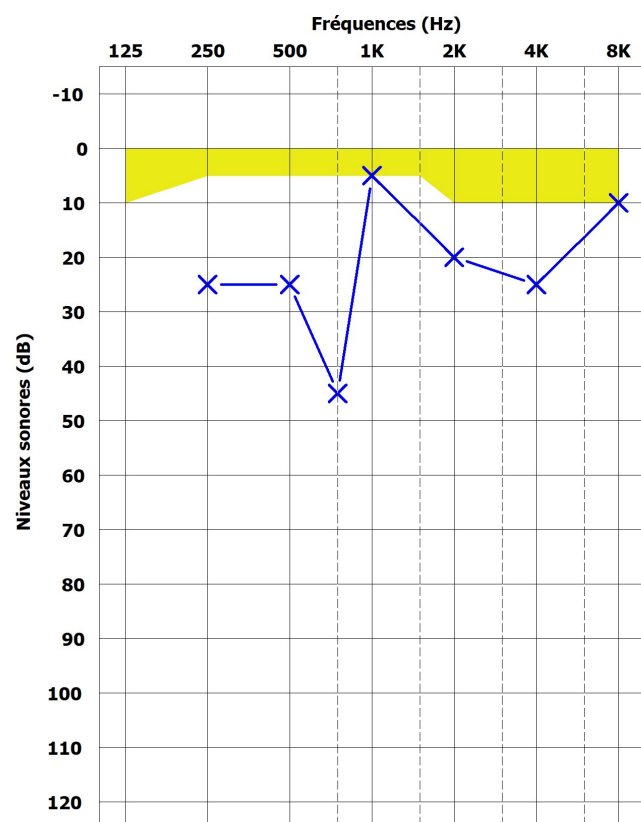

Oreille Gauche

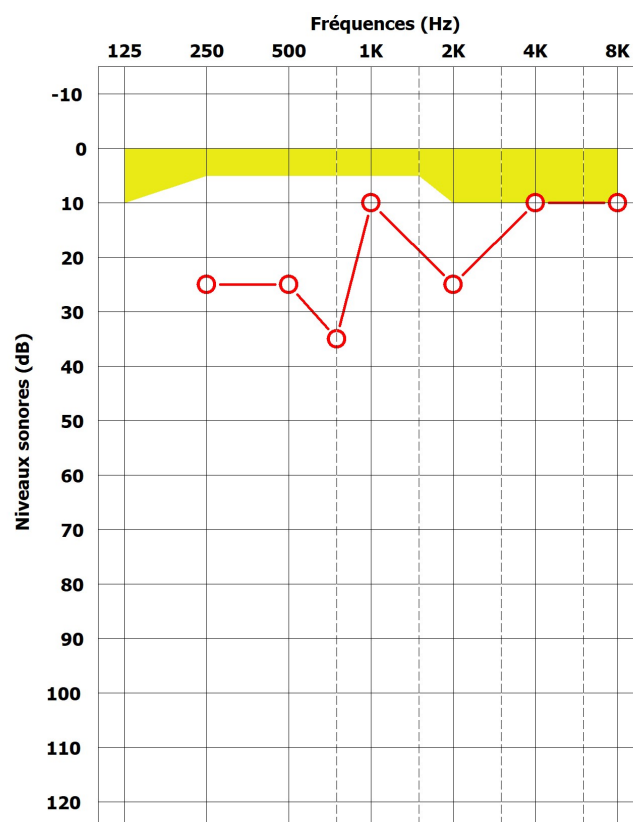

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	45	5		20		25		10
CA Droit		25	25	35	10		25		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes