



Données Patient

SOUHAM MUHAMED
KADFT

Date de naissance

01/01/1990

Age

34

Société

CHEC

ID

24091414412337481

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211


Numéro de série:

2111EAT690092


Date Calibration :

30/11/2021

Date du test: 14/09/2024 14:55:02
Durée: 4mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

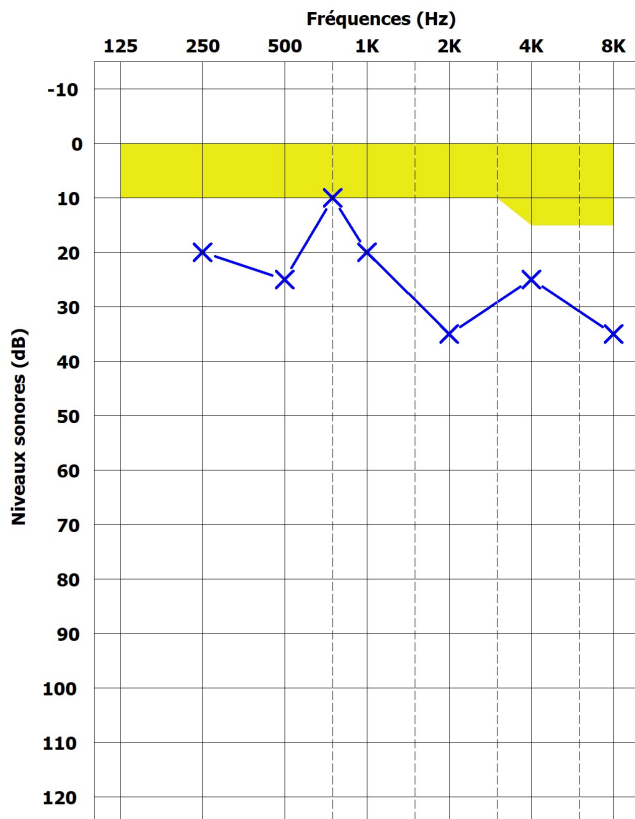

Oreille Gauche

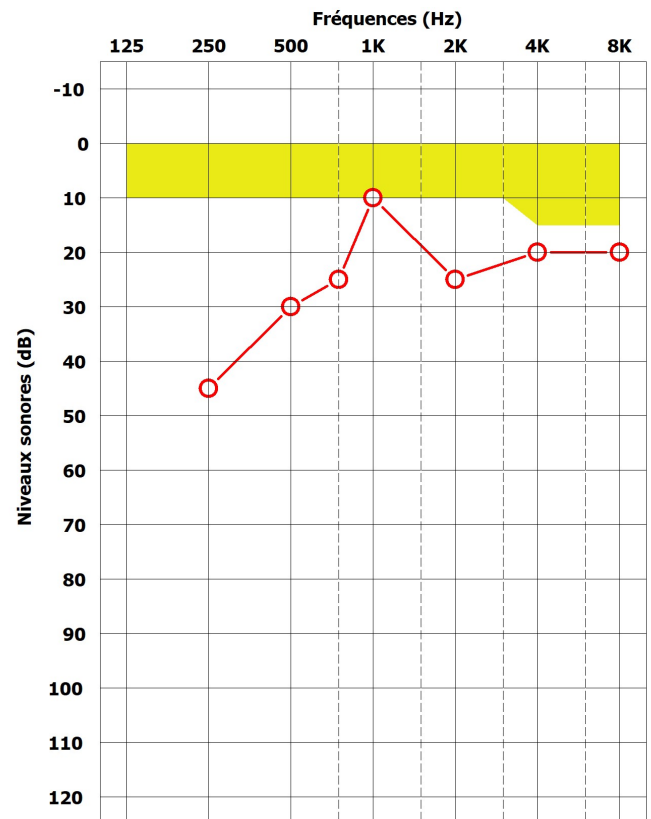

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	10	20		35		25		35
CA Droit		45	30	25	10		25		20		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes