



| Données Patient        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA YAMOUSSA</b> |                   |
| Date de naissance      | 20/06/1993        |
| Age                    | 31                |
| Société                | CHEC              |
| ID                     | 24070615265747967 |

Date du test: 06/07/2024 15:29:51  
 Durée: 3mn 03s  
 Type test Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

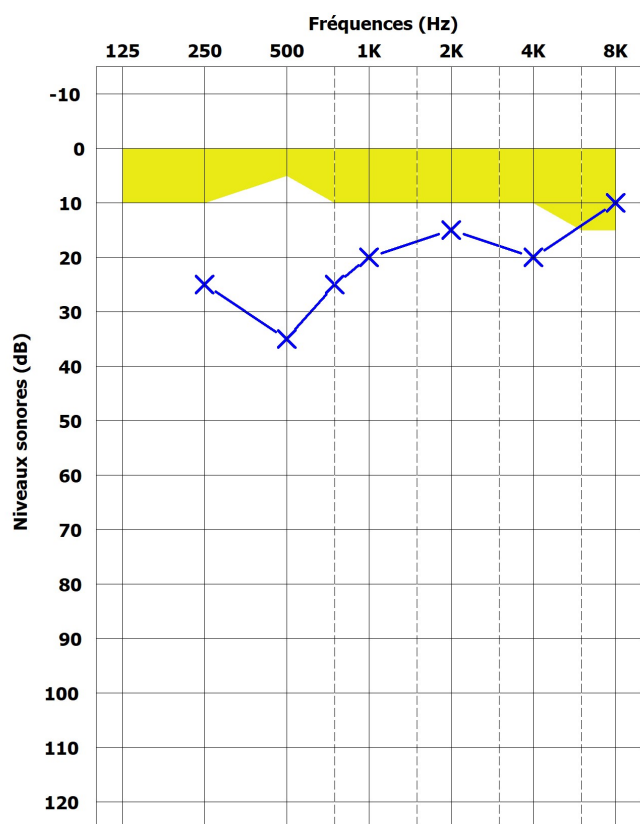

Oreille Gauche

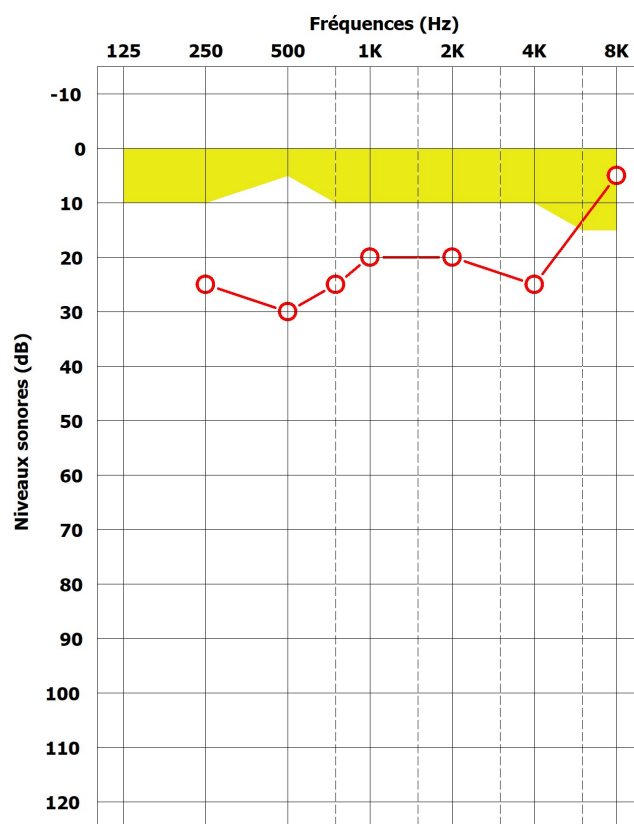

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 35  | 25  | 20 |     | 15 |    | 20 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 25  | 30  | 25  | 20 |     | 20 |    | 25 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 22,5 dB | --- |
| CA Droit        | 23,8 dB | --- |

Notes