


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 12:47:20
Durée: 8mn 28s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
FOFANA SAYON	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CHEC
ID	24072512214446357

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

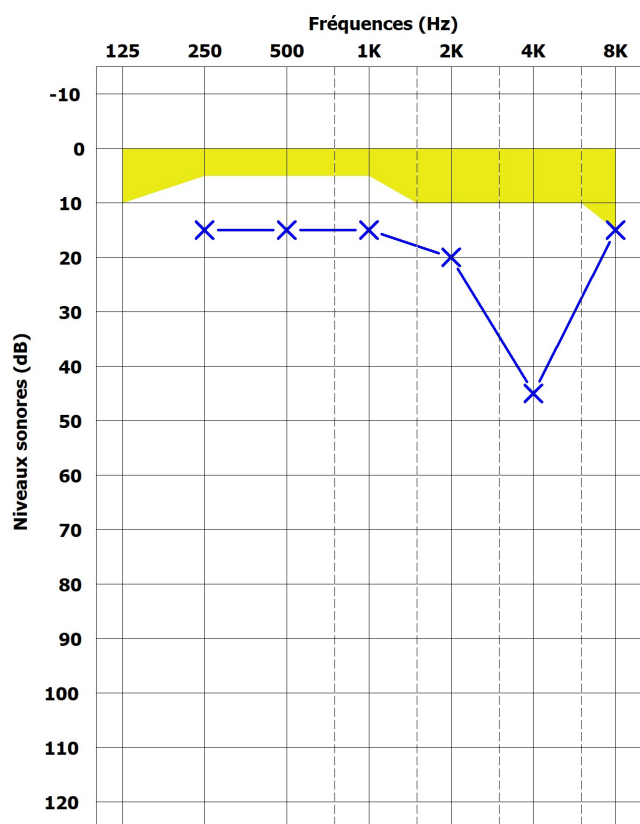

Oreille Gauche

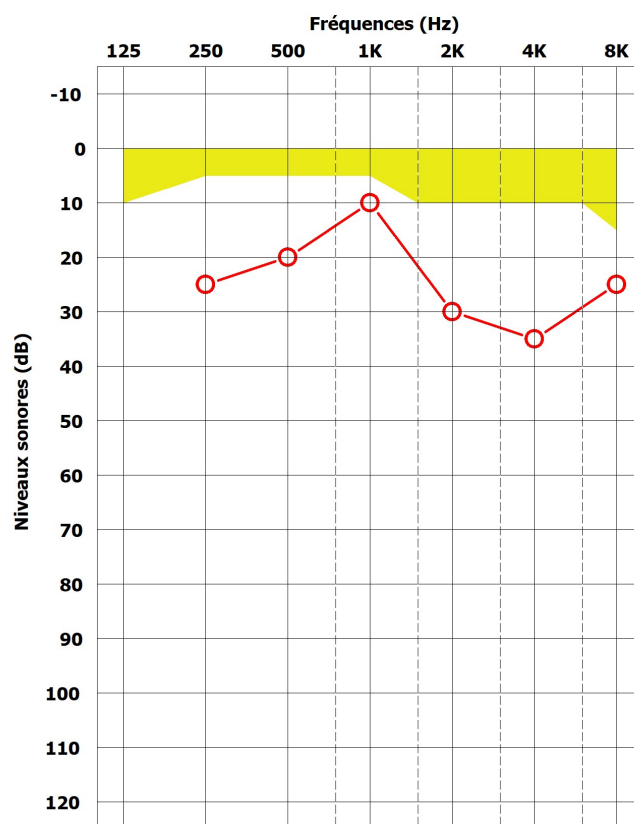

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		15		20		45		15
CA Droit		25	20		10		30		35		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes