


MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 14:14:18
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAKITE MAMOUDOU	
Date de naissance	12/09/1993
Age	30
Société	CHEC
ID	24090614103807556

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

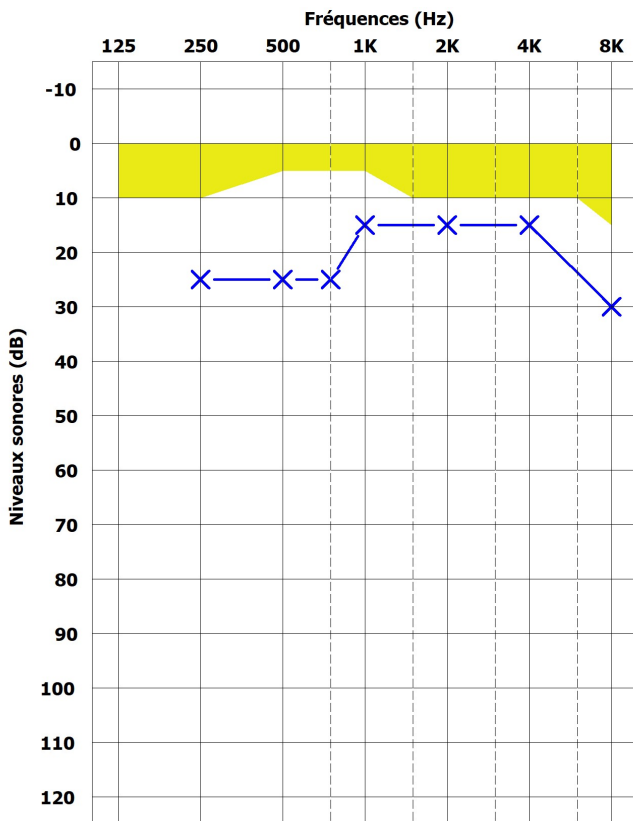

Oreille Gauche

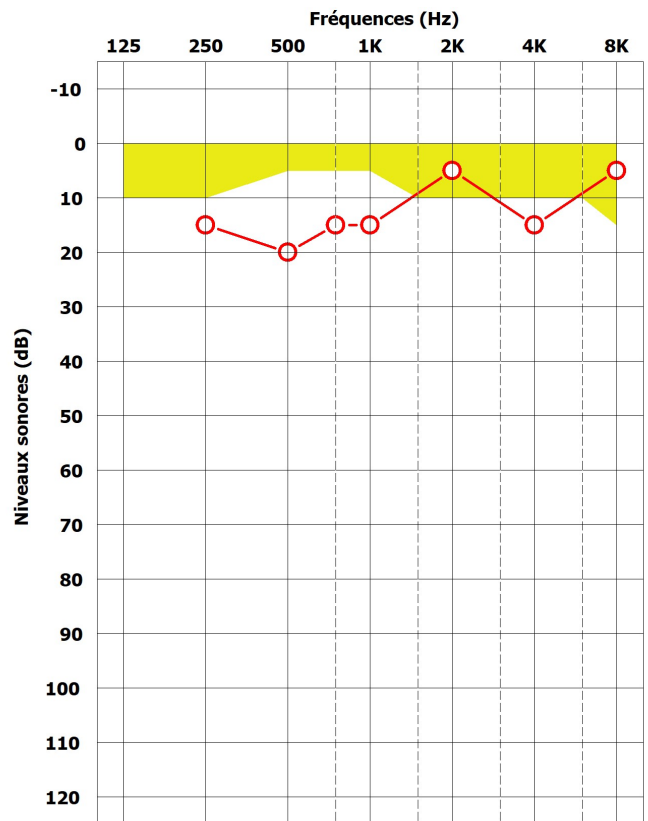

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		15		15		30
CA Droit		15	20	15	15		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes