



Données Patient	
SANOH MOHAMED	
Date de naissance	15/03/1986
Age	38
Société	CHEC
ID	2407052222254655

Date du test: 05/07/2024 22:41:11
Durée: 5mn 23s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

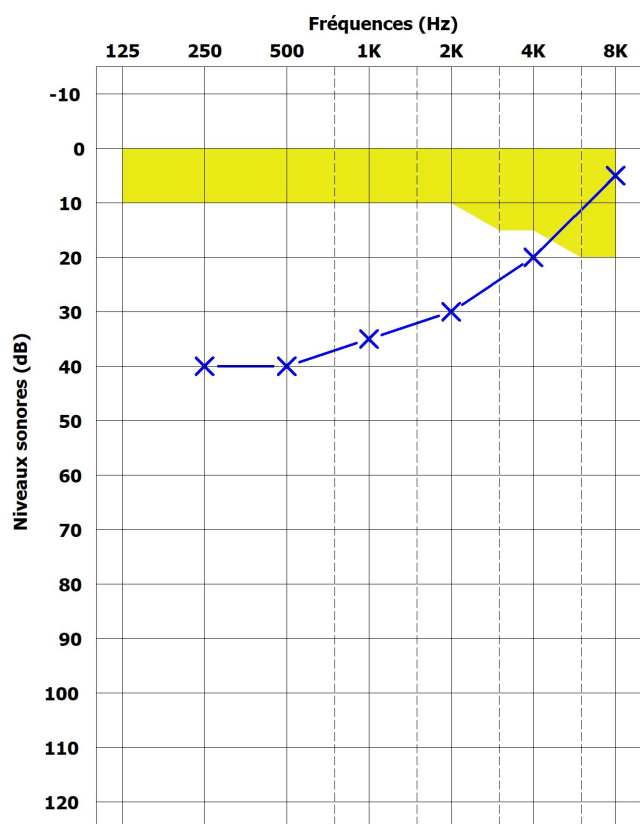

Oreille Gauche

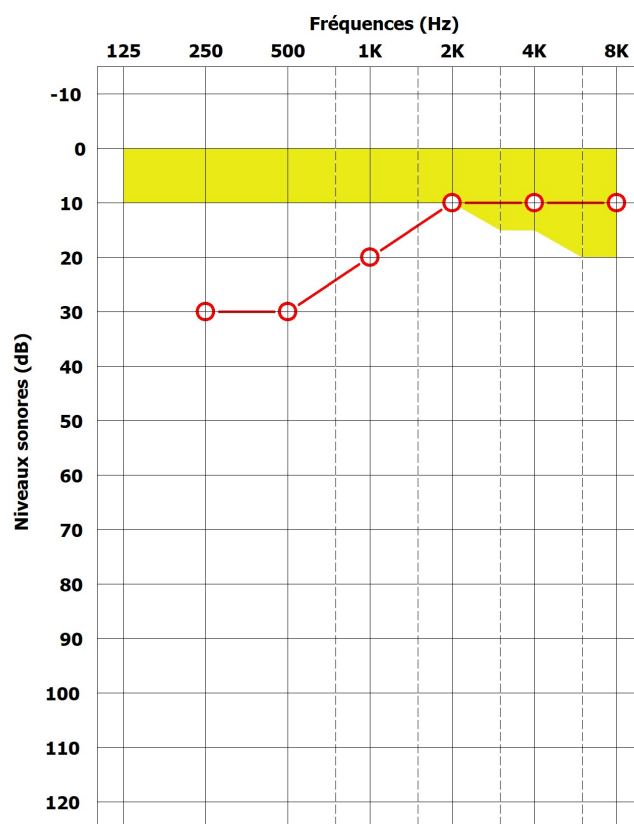

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	40		35		30		20		5
CA Droit		30	30		20		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes