



MED VIE

Date du test: 25/07/2024 11:51:31
Durée: 4mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

SOUMAH Sekou

Date de naissance

27/12/1993

Age

30

Société

CHEC

ID

24072511394336042

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

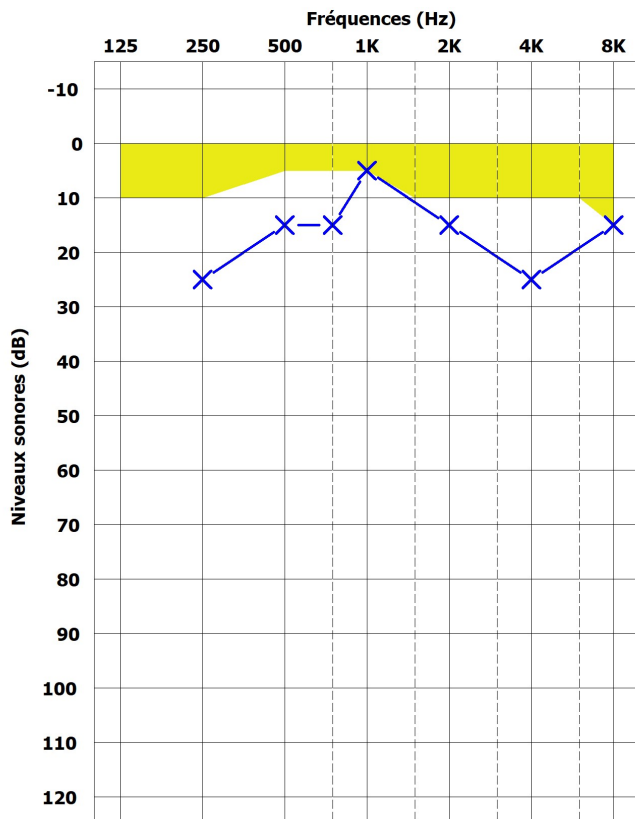

Oreille Gauche

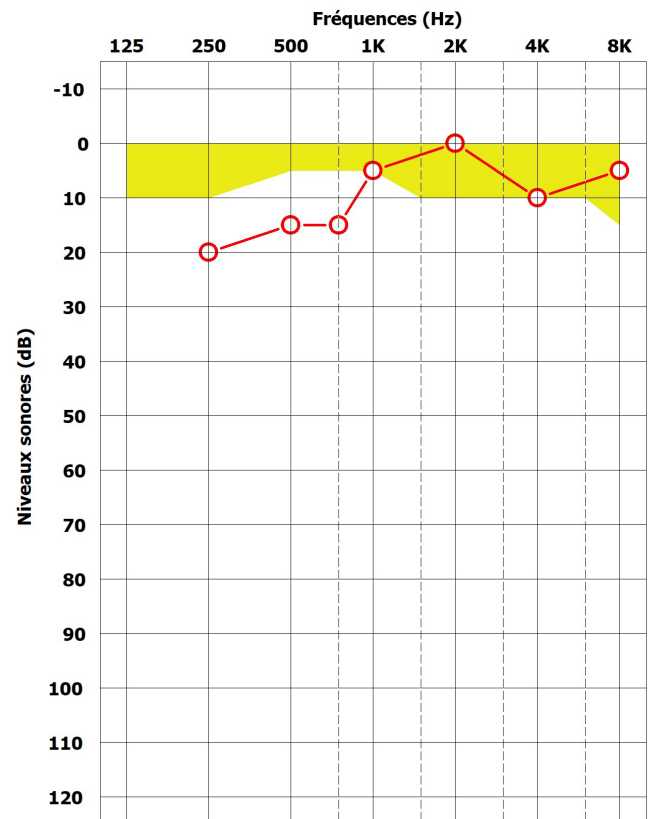

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	15	5		15		25		15
CA Droit		20	15	15	5		0		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes