


MEDVIE


Date du test: 24/07/2024 14:43:39
Durée: 3mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SEGURA AFKE DANIEL ARNOI DO
Date de naissance	01/02/1968
Age	56
Société	LENSE CORPS
ID	24072414414227238

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

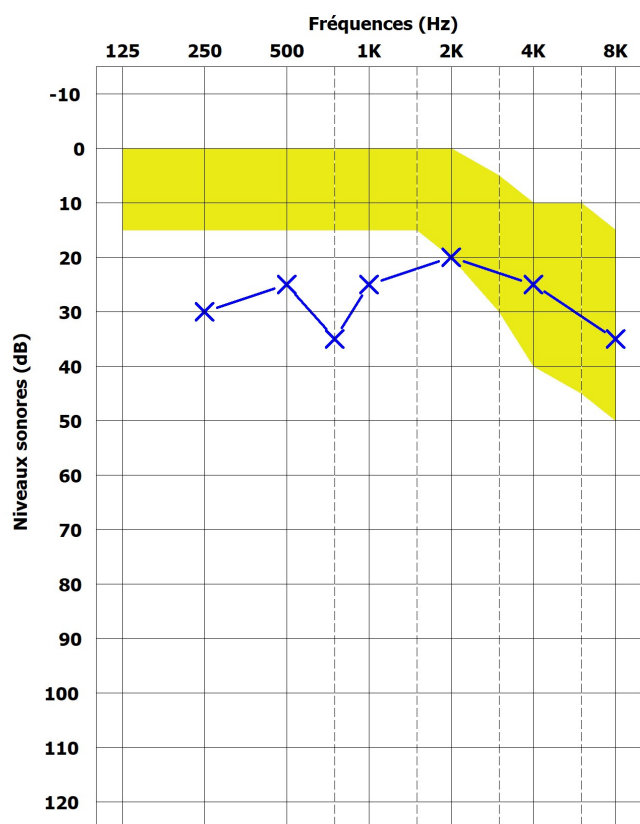

Oreille Gauche

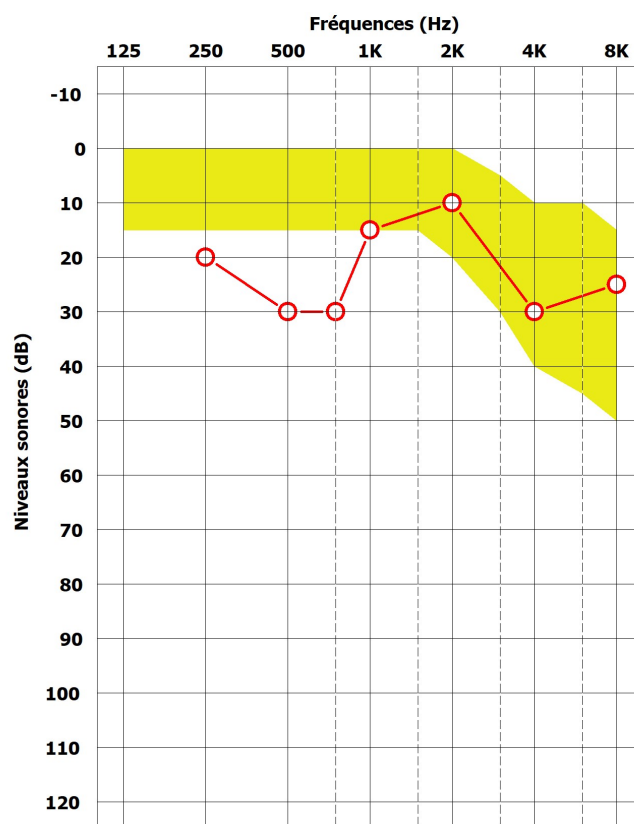

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	35	25		20		25		35
CA Droit		20	30	30	15		10		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes