

MEDVIE


Date du test: 10/06/2024 15:51:38

Durée: 4mn 29s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO BOUBACAR	
Date de naissance	10/02/1982
Age	42
Société	MV/LENSE CORPS
ID	24061015492317162

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

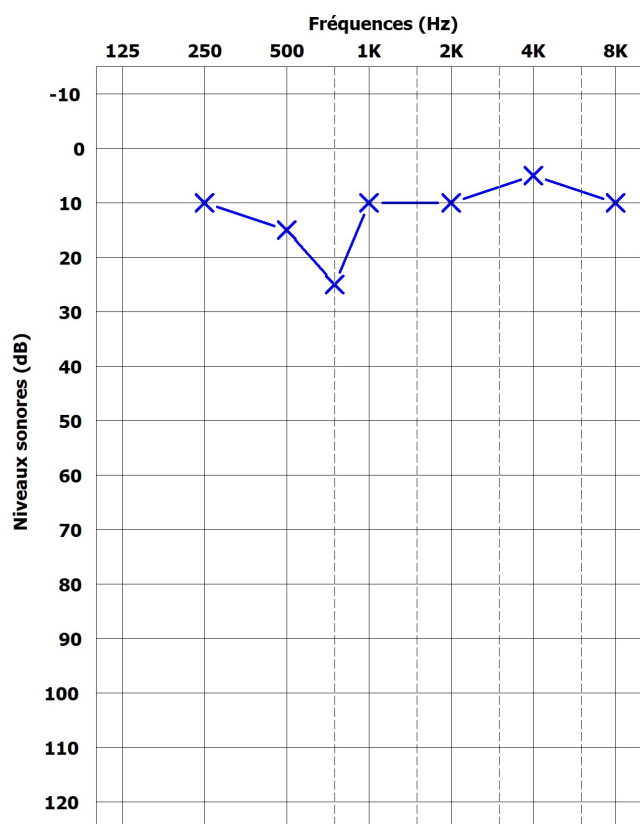

Oreille Gauche

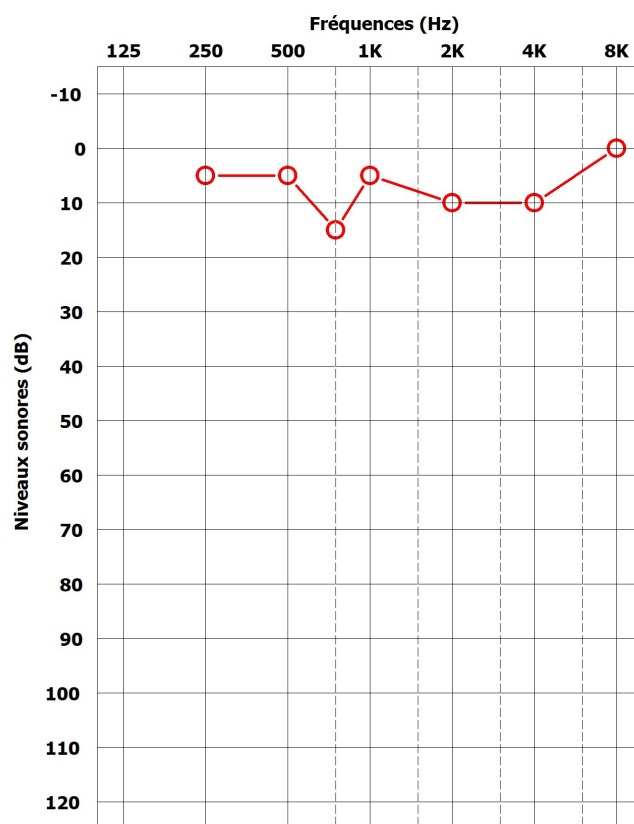

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	25	10		10		5		10
CA Droit		5	5	15	5		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes