


MEDVIE


Date du test: 26/06/2024 11:47:00

Durée: 5mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

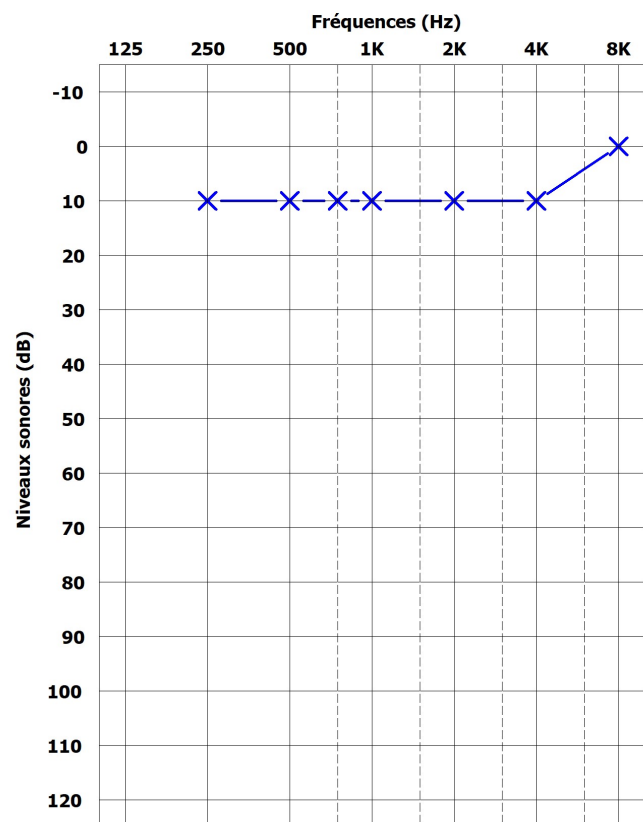

Oreille Gauche

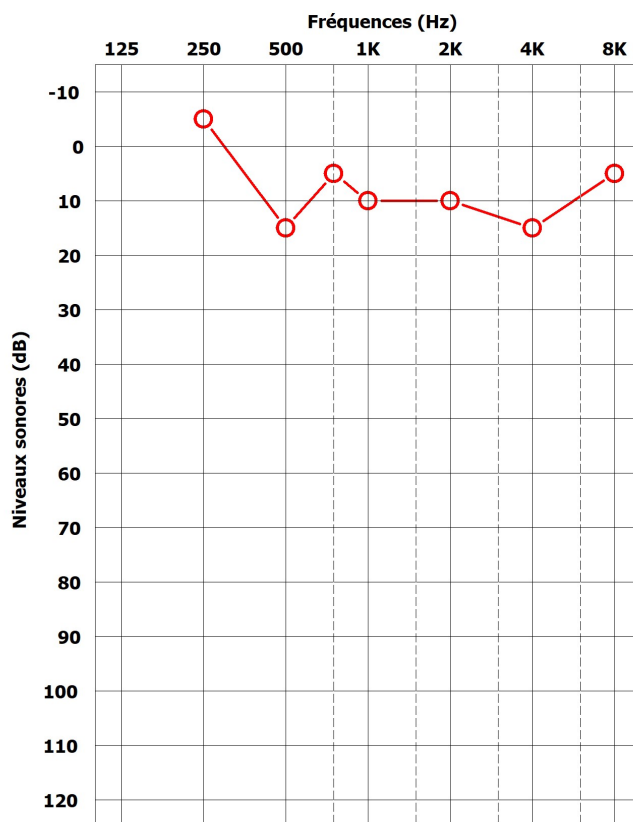

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		10		10		0
CA Droit		-5	15	5	10		10		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	
NDIAYE IBRAHIMA SORY	
Date de naissance	08/04/1989
Age	35
Société	LC
ID	24062611423418611

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021