

MEDVIE BEYLA

Date du test: 02/01/2025 12:52:55

Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA ISSA

Date de naissance

01/01/1990

Age

35

Société

SOGETRAC

ID

25010212500104127

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

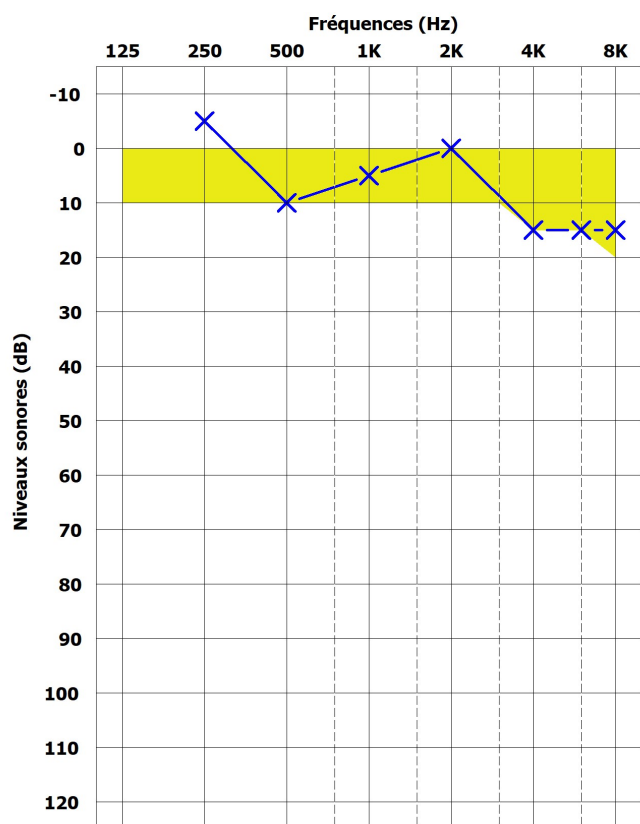

Oreille Gauche

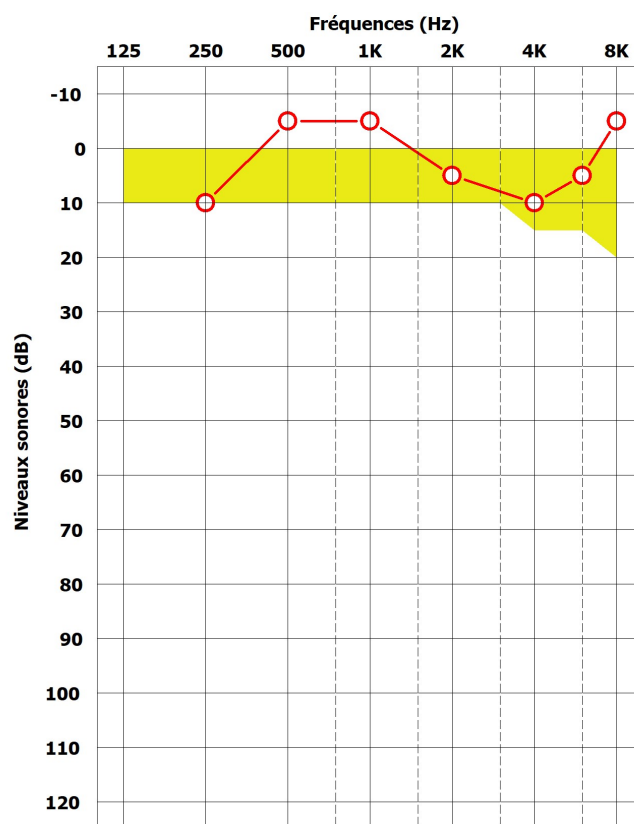

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10		5		0		15	15	15
CA Droit		10	-5		-5		5		10	5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	-5,0 dB

Notes