


MEDVIE


Date du test: 10/10/2024 14:55:35  
Durée: 5mn 36s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| DOUMBOUYA Mabalou |                   |
| Date de naissance | 03/11/1999        |
| Age               | 24                |
| Société           | EMS               |
| ID                | 24101014502945060 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

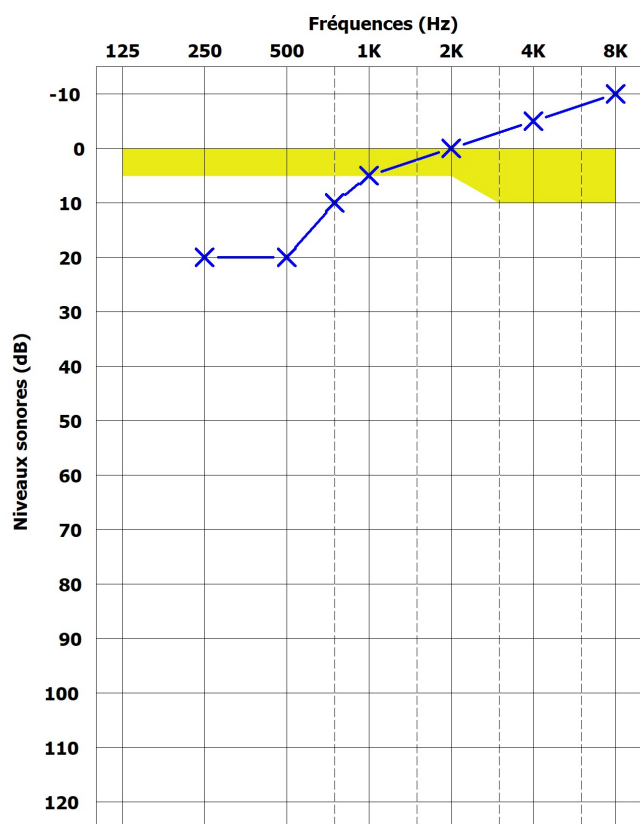

Oreille Gauche

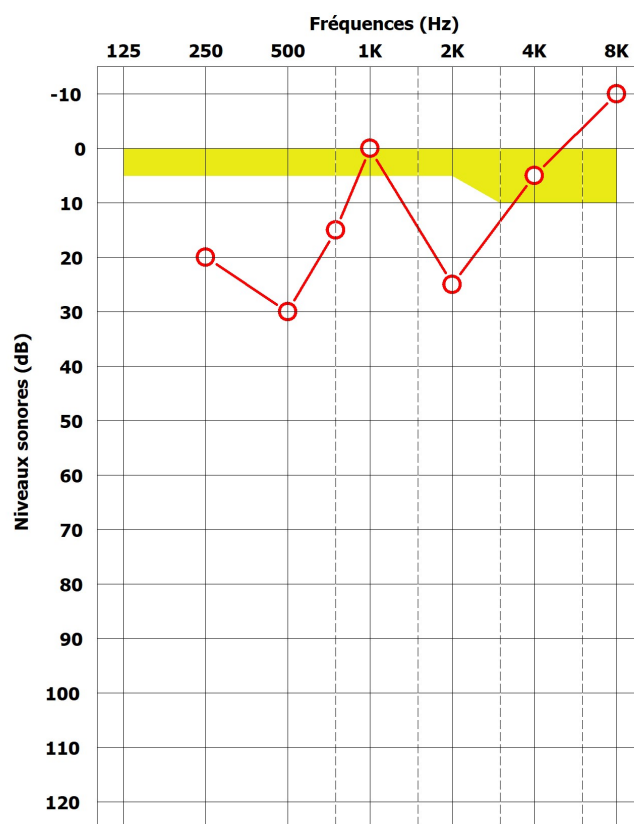

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 20  | 20  | 10  | 5  |     | 0  |    | -5 |    | -10 |
| CA Droit  |     | 20  | 30  | 15  | 0  |     | 25 |    | 5  |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 5,0 dB  | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes