


MEDVIE


Date du test: 10/10/2024 16:30:05
Durée: 4mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO FATOUMATA RINTA TANOI
Date de naissance	13/09/1994
Age	30
Société	EMS
ID	24101016273086962

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

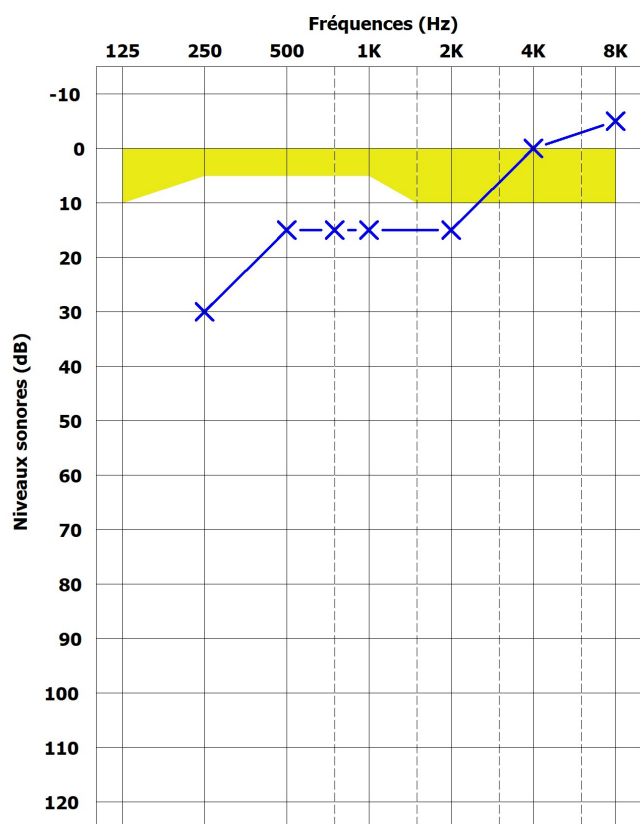

Oreille Gauche

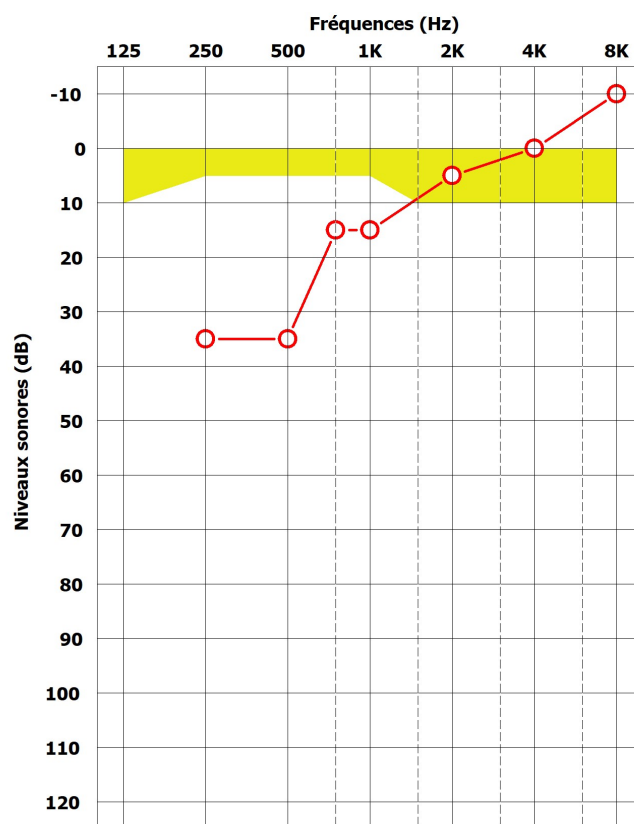

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	15	15		15		0		-5
CA Droit		35	35	15	15		5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes