


MED VIE


Date du test: 16/07/2024 12:24:07

Durée: 5mn 13s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

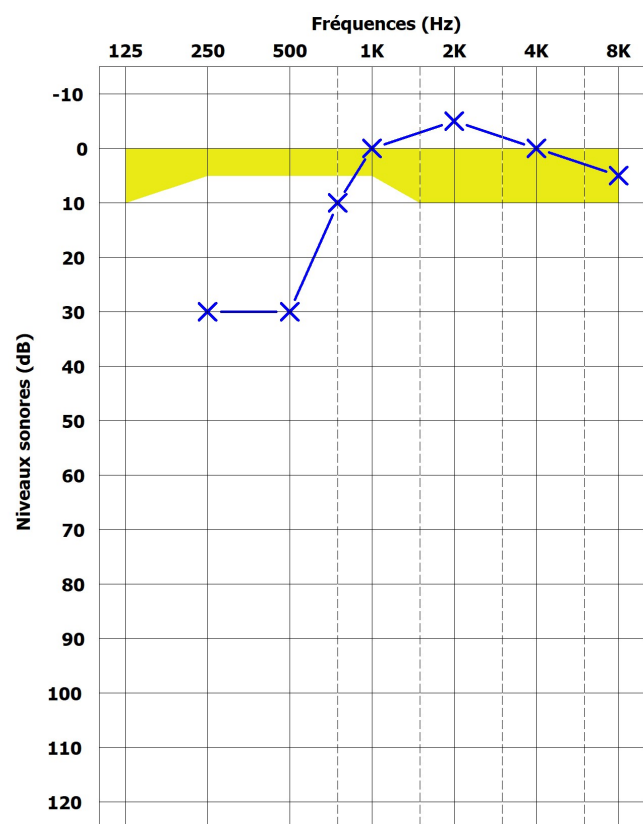

Oreille Gauche

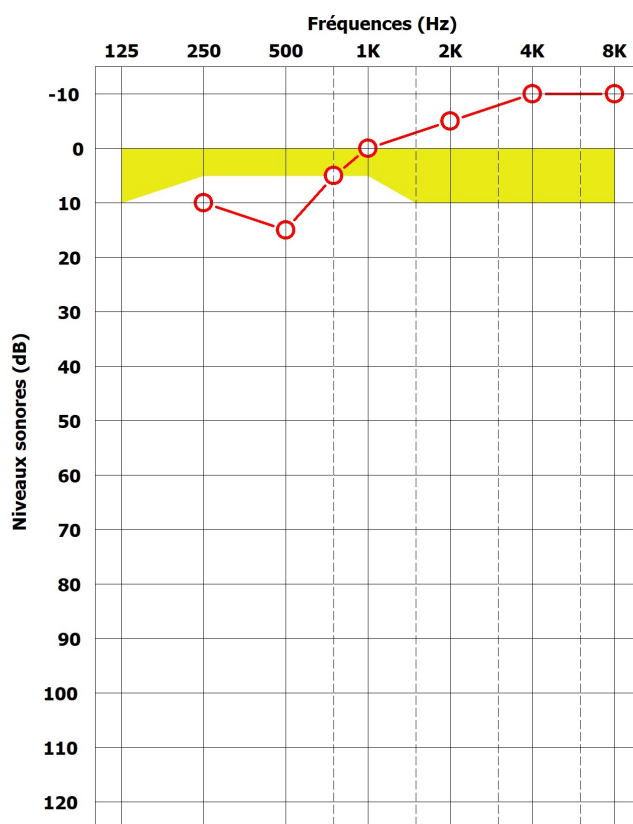

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	10	0		-5		0		5
CA Droit		10	15	5	0		-5		-10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes

Données Patient	EL OMEIRY MOHAMED HASSAN
Date de naissance	11/04/1996
Age	28
Société	EMS
ID	24071612203985327

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021