

MEDVIE


Date du test: 28/07/2025 10:24:06

Durée: 4mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	GONCALVES PEDRO
Date de naissance	02/08/1970
Age	54
Société	MOTA ENGIL
ID	25072810145832159

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

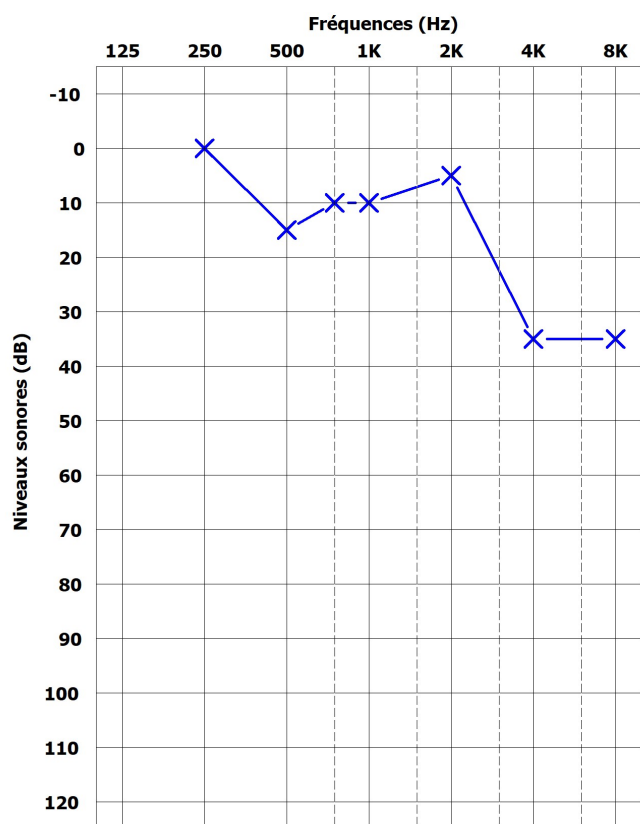

Oreille Gauche

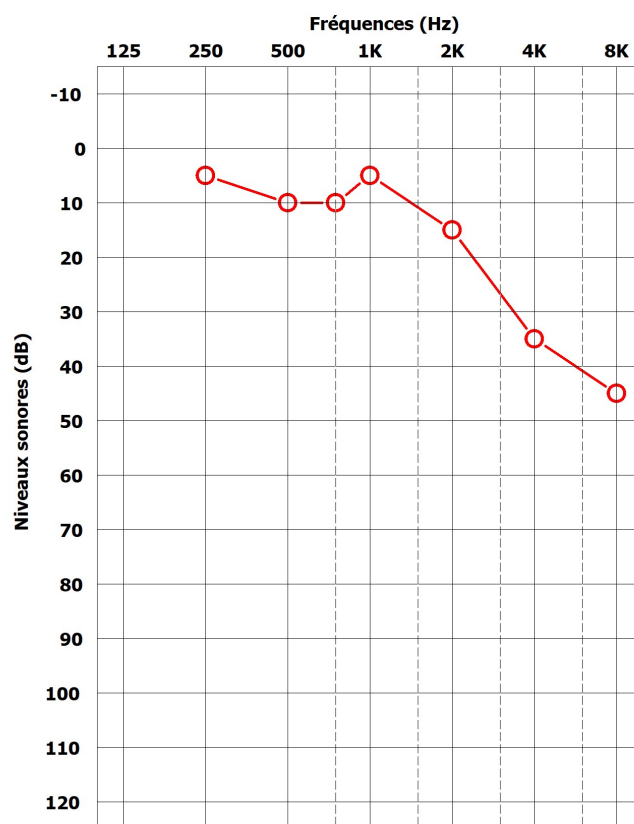

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	10	10		5		35		35
CA Droit		5	10	10	5		15		35		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes