

MEDVIE


Date du test: 28/03/2025 09:53:43

Durée: 4mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	RAUTRAUT WILLIAM
Date de naissance	15/09/1983
Age	41
Société	MOTA ENGIL
ID	25032809511434196

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

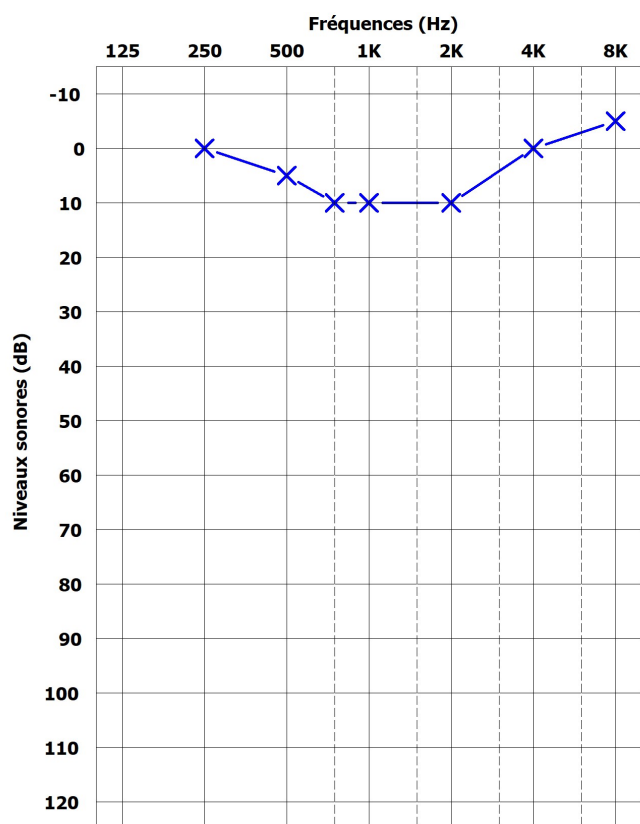

Oreille Gauche

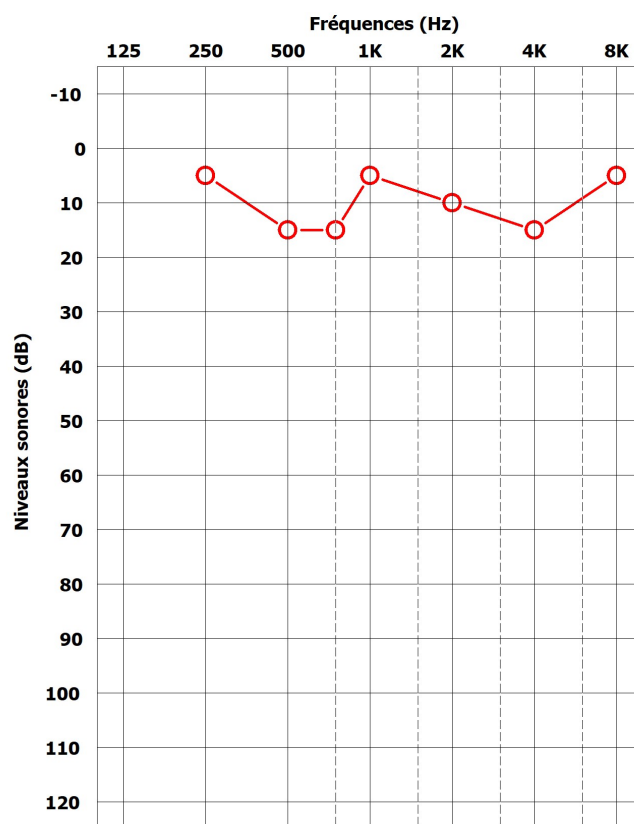

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	10		10		0		-5
CA Droit		5	15	15	5		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes