


MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 11:25:20
Durée: 2mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MONTEIRO SILVA	
Date de naissance	09/12/1974
Age	50
Société	MOTAE
ID	25082110324688627

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

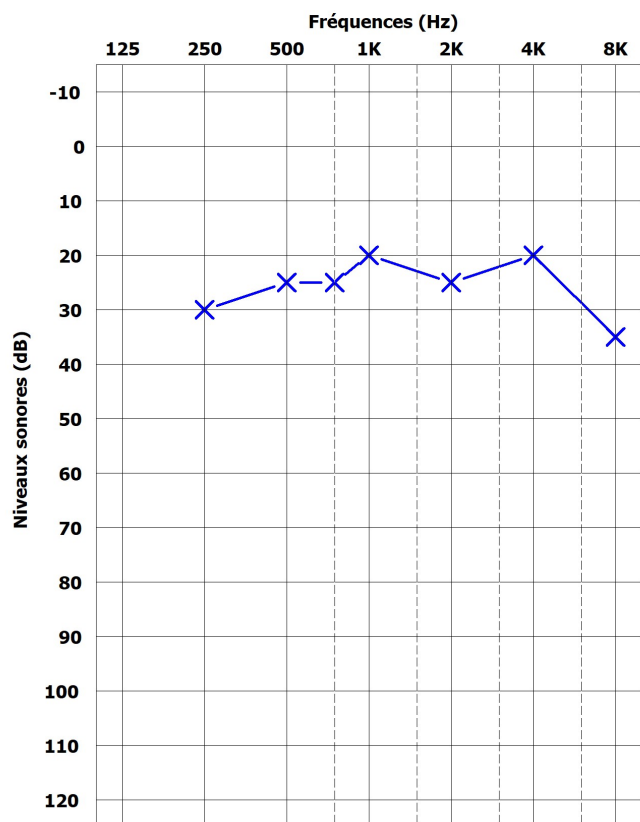

Oreille Gauche

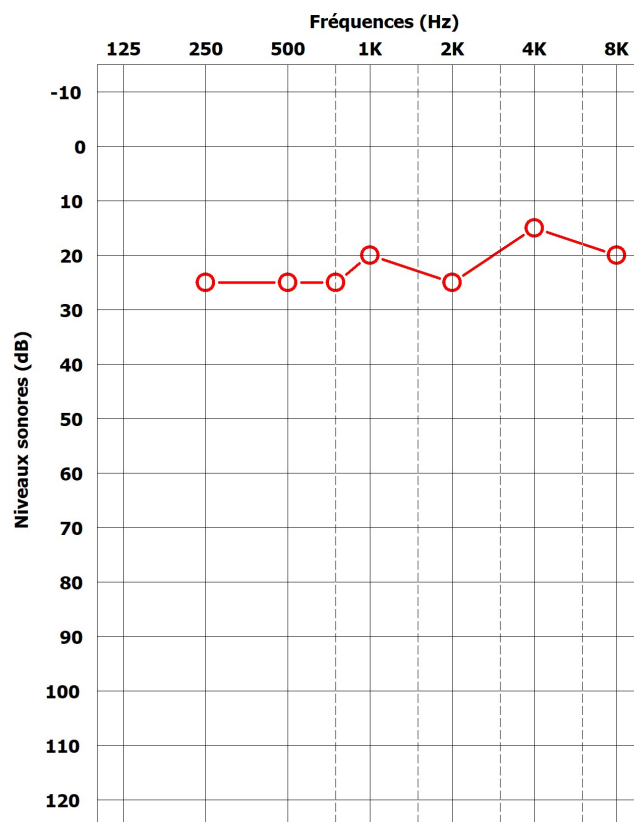

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		25		20		35
CA Droit		25	25	25	20		25		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes