

MEDVIE


Date du test: 13/08/2025 09:32:20

Durée: 4mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CASTRO GUIMARAES
Date de naissance	10/04/1973
Age	52
Société	MOTA ENGL
ID	25081309274067079

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

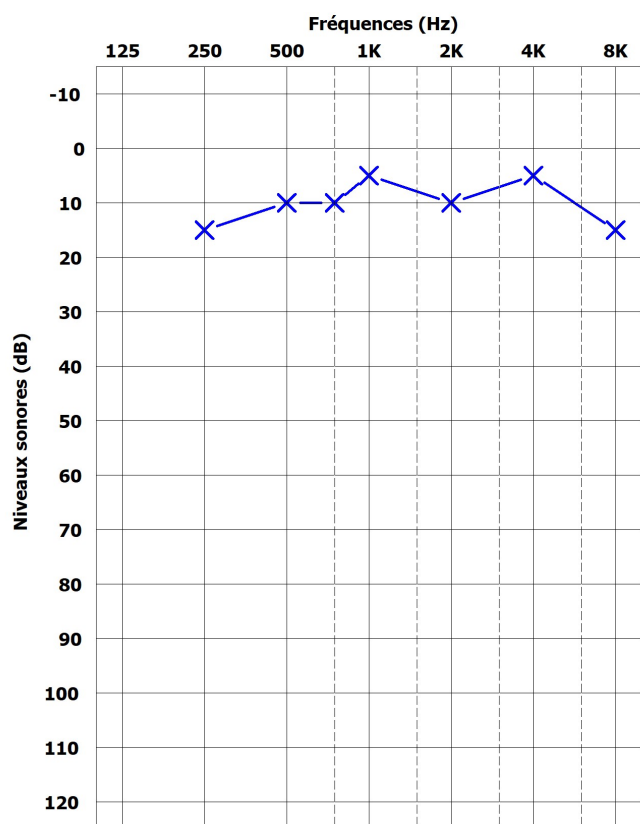

Oreille Gauche

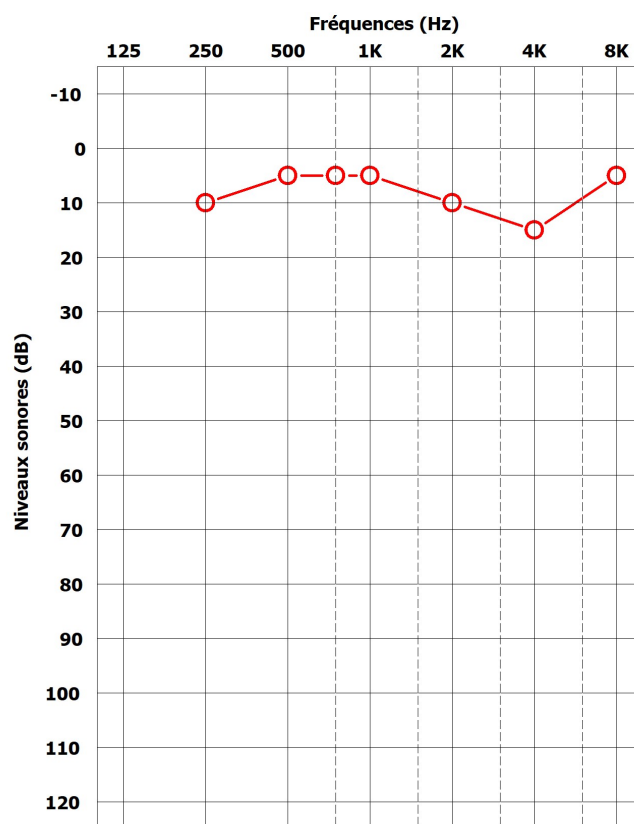

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	5		10		5		15
CA Droit		10	5	5	5		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes