


MEDVIE


Date du test: 06/08/2024 13:34:01  
Durée: 4mn 39s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | GBAMOU KPAQUILE<br>FI VIS |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Date de naissance | 07/04/1993        |                           |
| Age               | 31                |                           |
| Société           | SIEC              |                           |
| ID                | 24080613320081740 |                           |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

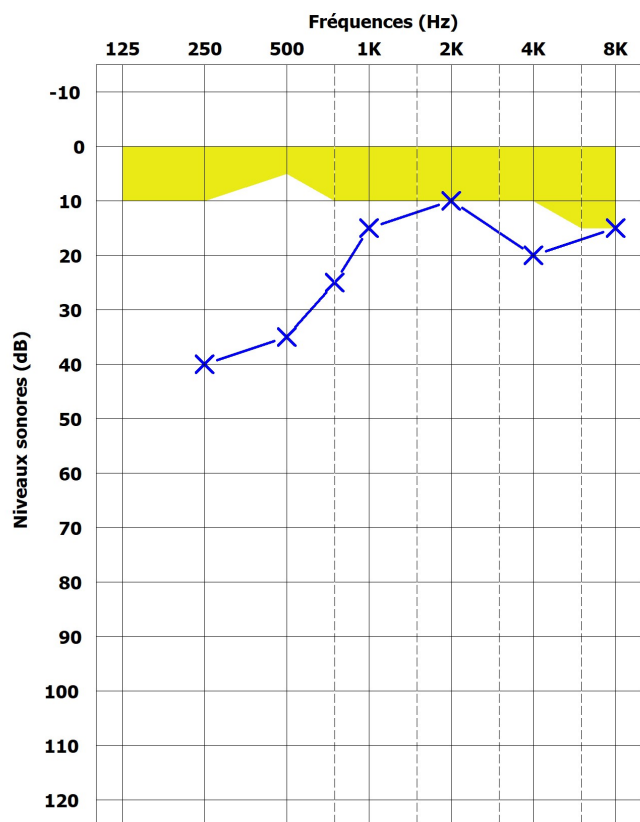

Oreille Gauche

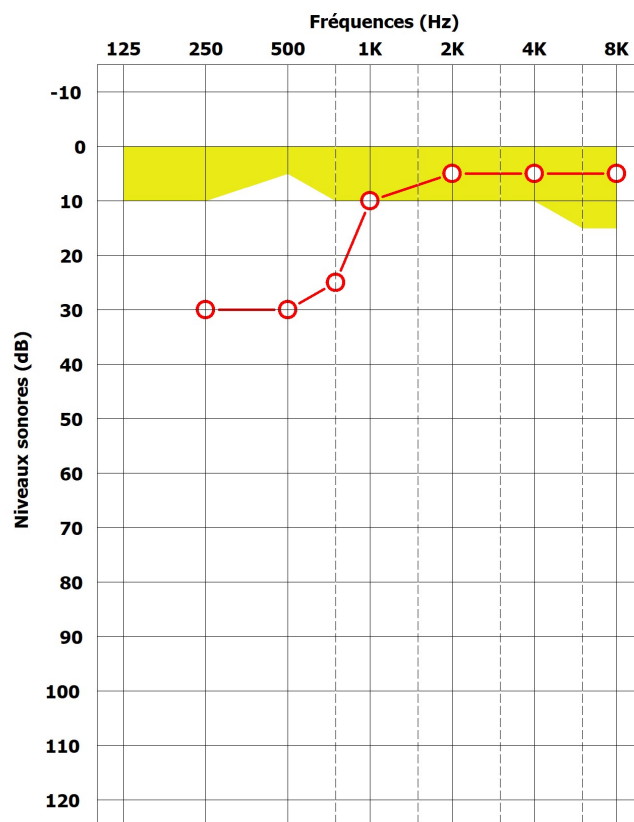

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 40  | 35  | 25  | 15 |     | 10 |    | 20 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 25  | 10 |     | 5  |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes