


MEDVIE


Date du test: 27/08/2024 14:40:38
Durée: 3mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		NABE SIDAFA
Date de naissance	20/05/1989	
Age	35	
Société	SIEC	
ID	24082714385239772	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

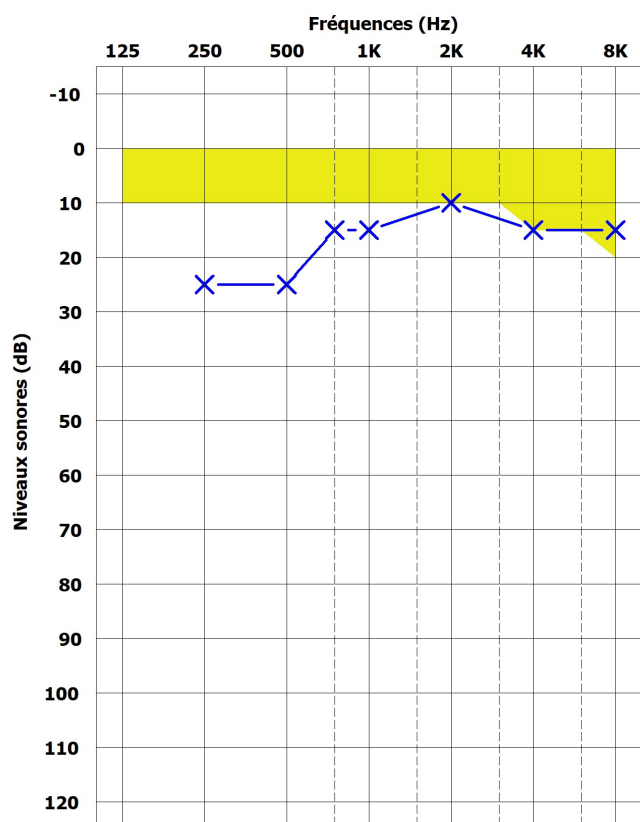

Oreille Gauche

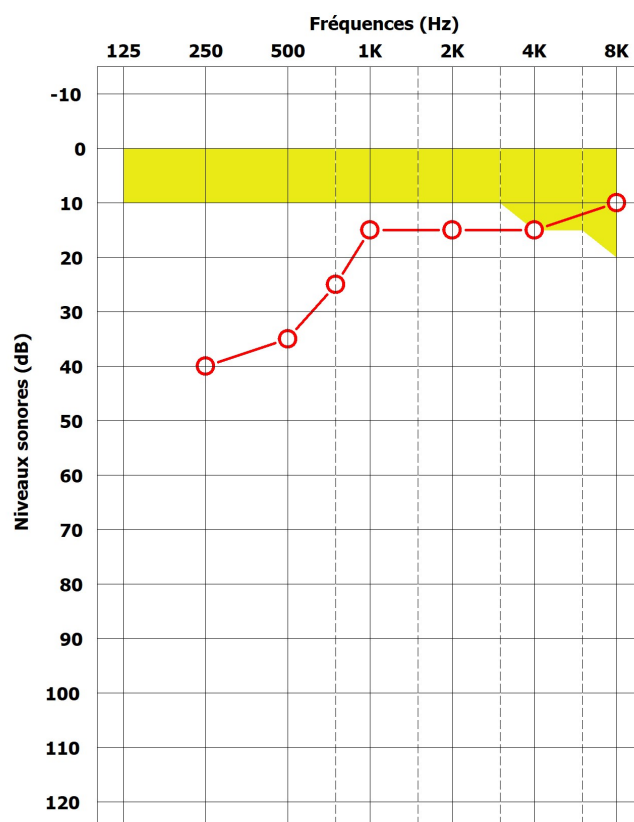

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	15		10		15		15
CA Droit		40	35	25	15		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes