


MEDVIE


Date du test: 08/08/2024 13:43:55
Durée: 5mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
OUENDENO FELIX FAGRON	
Date de naissance	10/11/1985
Age	38
Société	SYLVA
ID	24080813380701755

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

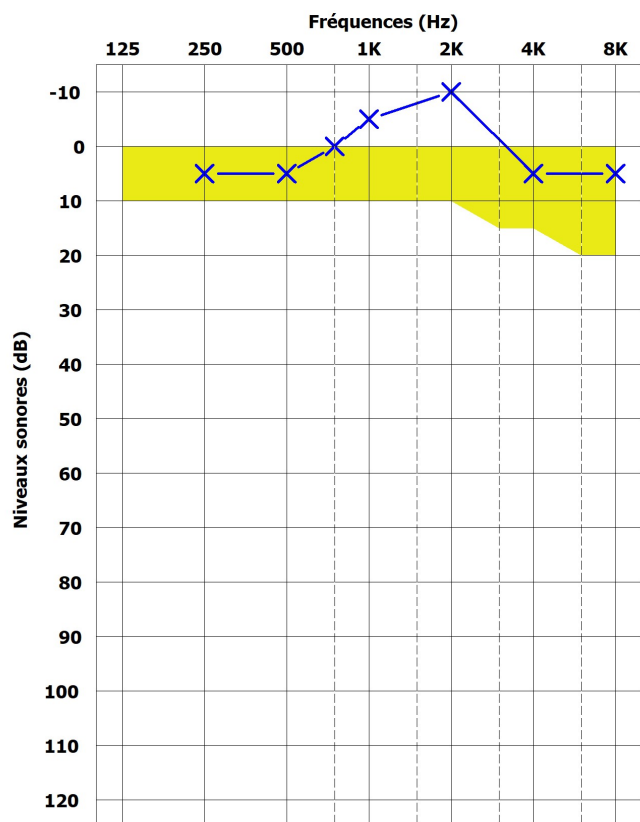

Oreille Gauche

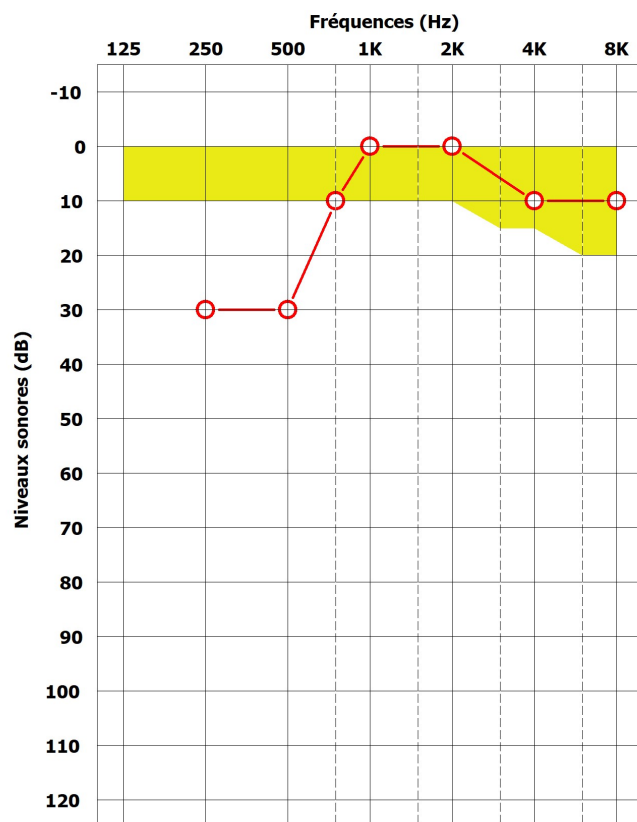

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	0	-5		-10		5		5
CA Droit		30	30	10	0		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes