

MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:46:46

Durée: 5mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DORE Bernard
Date de naissance	01/01/1962
Age	62
Société	SYLVATROP
ID	24081412441143710

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

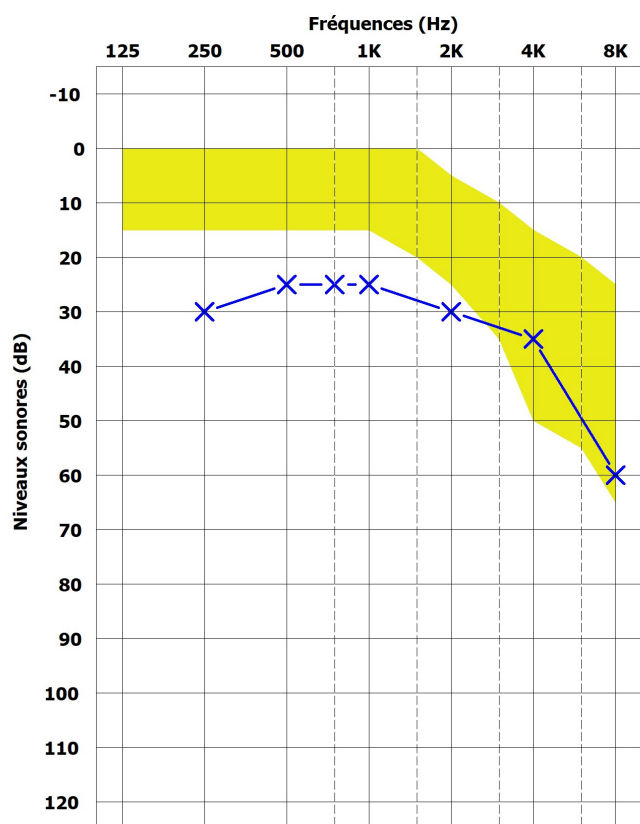

Oreille Gauche

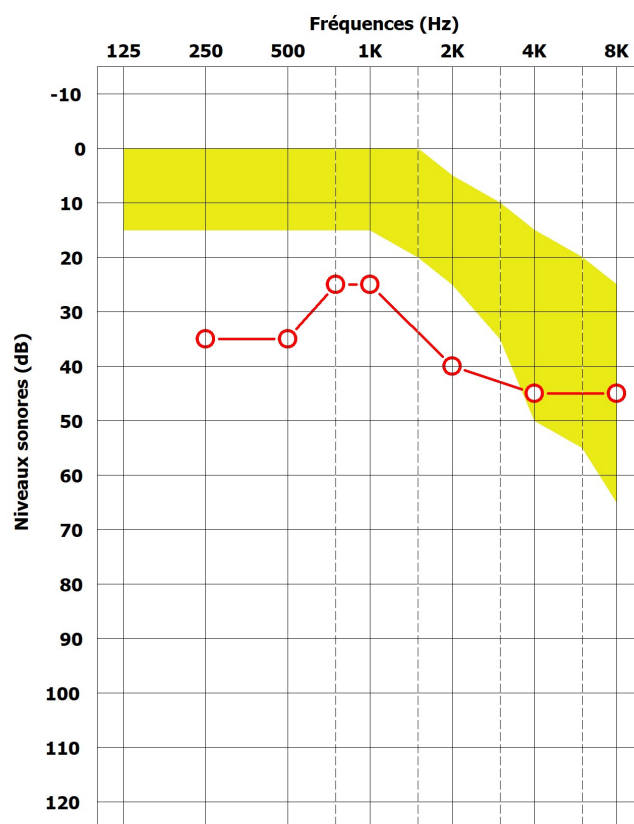

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	25		30		35		60
CA Droit		35	35	25	25		40		45		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes