

MEDVIE


Date du test: 15/10/2024 10:55:17

Durée: 3mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DORE TOKPA SENY	
Date de naissance	04/05/1985
Age	39
Société	SYLVA
ID	24101510483690700

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

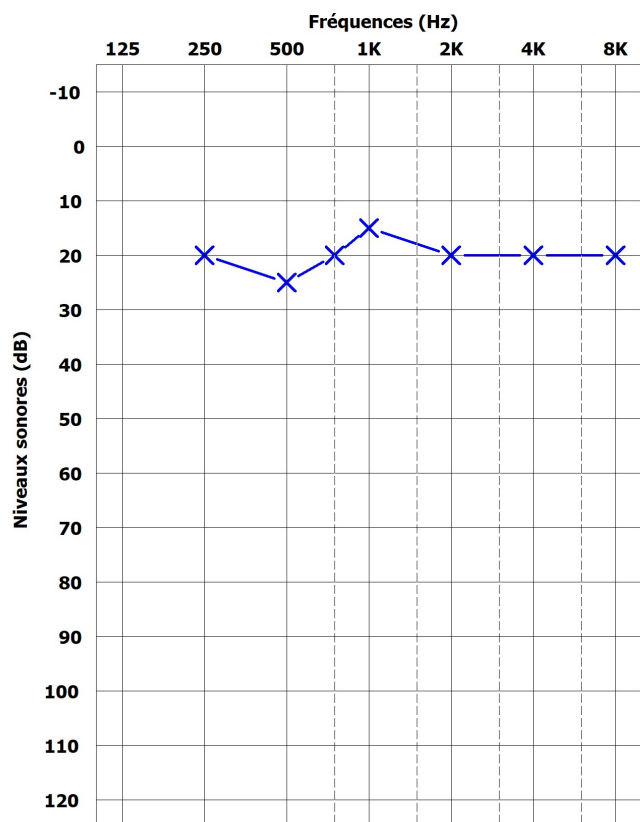

Oreille Gauche

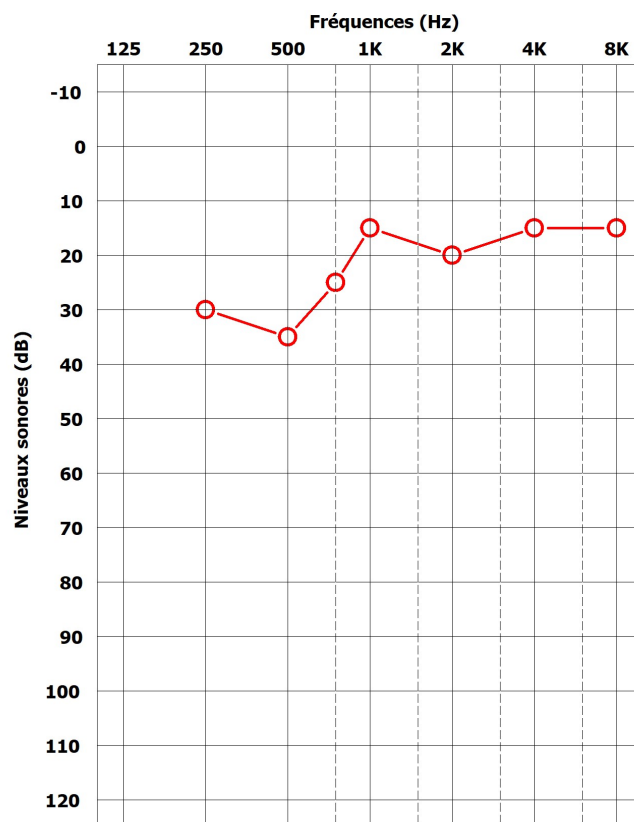

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	15		20		20		20
CA Droit		30	35	25	15		20		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes