


MEDVIE


Date du test: 08/08/2024 13:04:56

Durée: 6mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

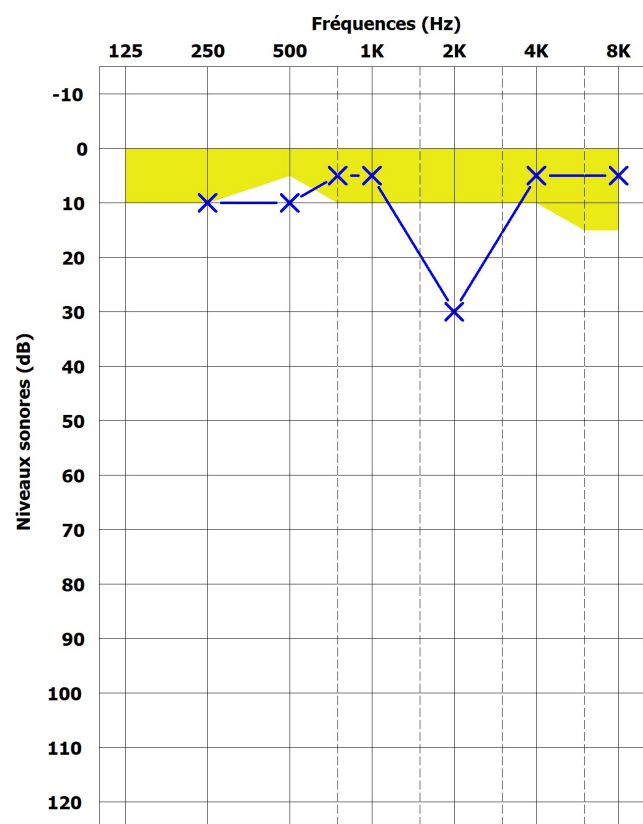

Oreille Gauche

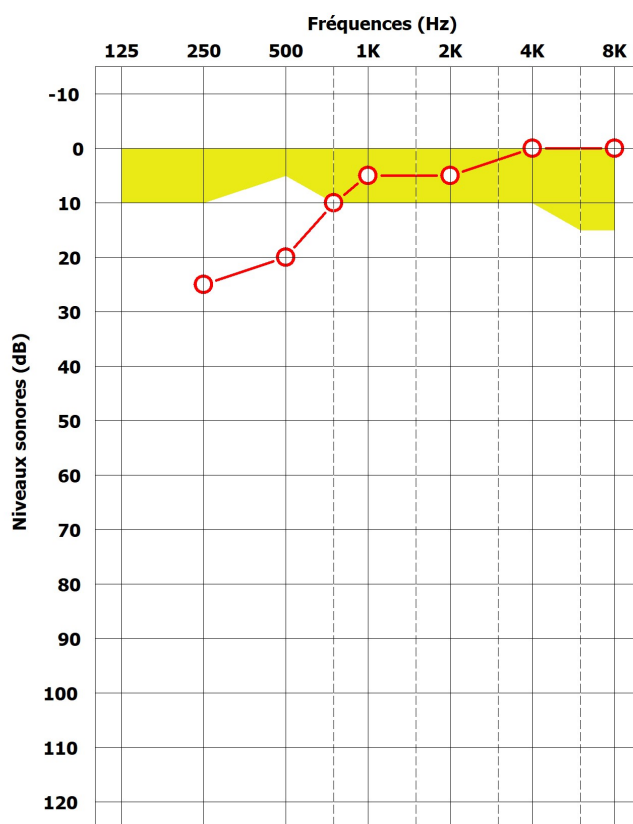

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	5		30		5		5
CA Droit		25	20	10	5		5		0		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient

TRAORE NESTOR

Date de naissance

26/02/1993

Age

31

Société

SYLVA

ID

24080813031896989

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021