


MEDVIE


Date du test: 19/09/2024 12:30:17
Durée: 4mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KALLO LAMINE	
Date de naissance	13/01/1974
Age	50
Société	SYLVATOR
ID	24091912275403553

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

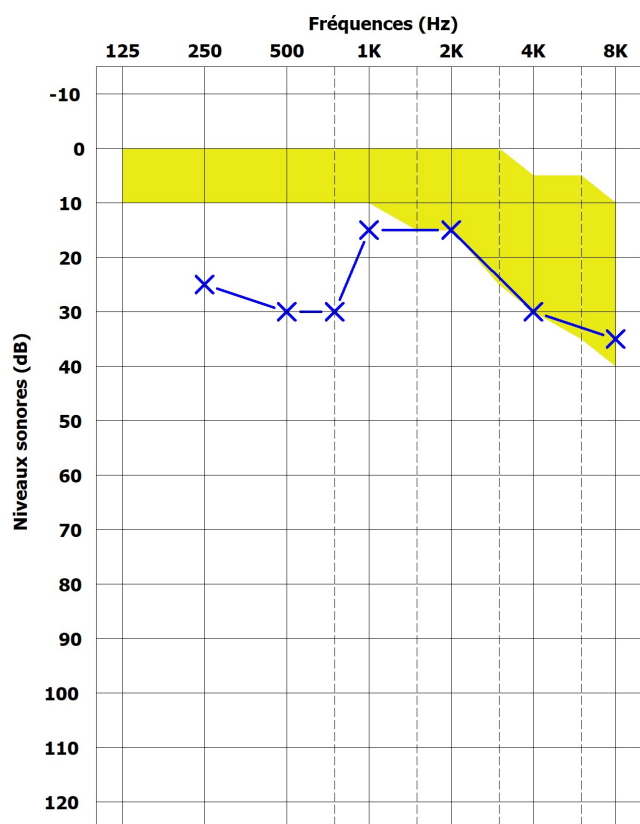

Oreille Gauche

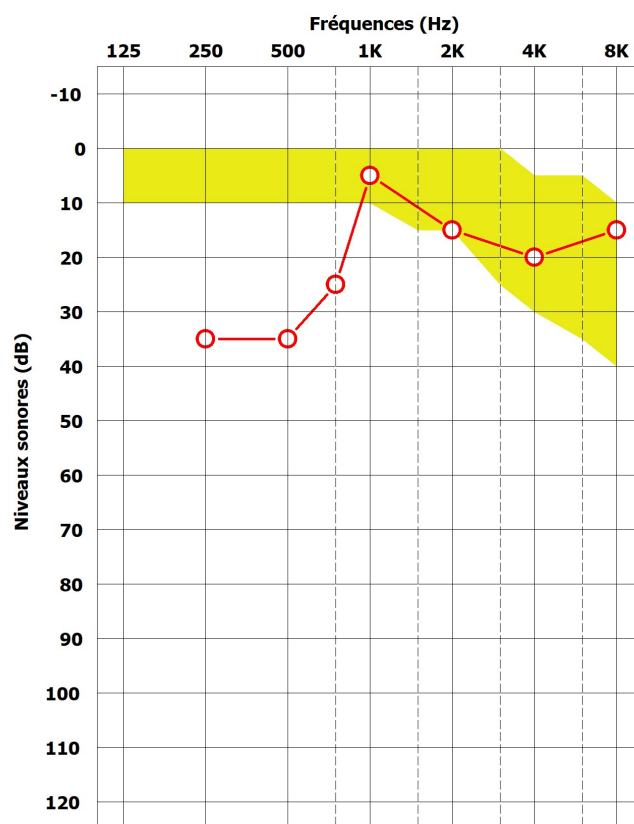

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	15		15		30		35
CA Droit		35	35	25	5		15		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes