


MEDVIE


Date du test: 08/08/2024 13:32:32
Durée: 9mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BALDE AMADOU SADJO
Date de naissance	03/07/1983
Age	41
Société	SYLVA
ID	24080813295106916

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

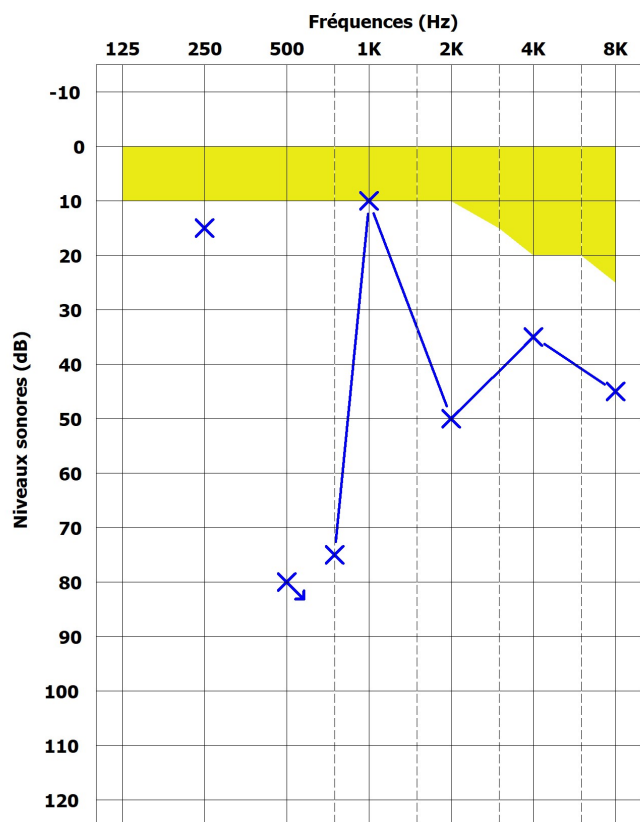

Oreille Gauche

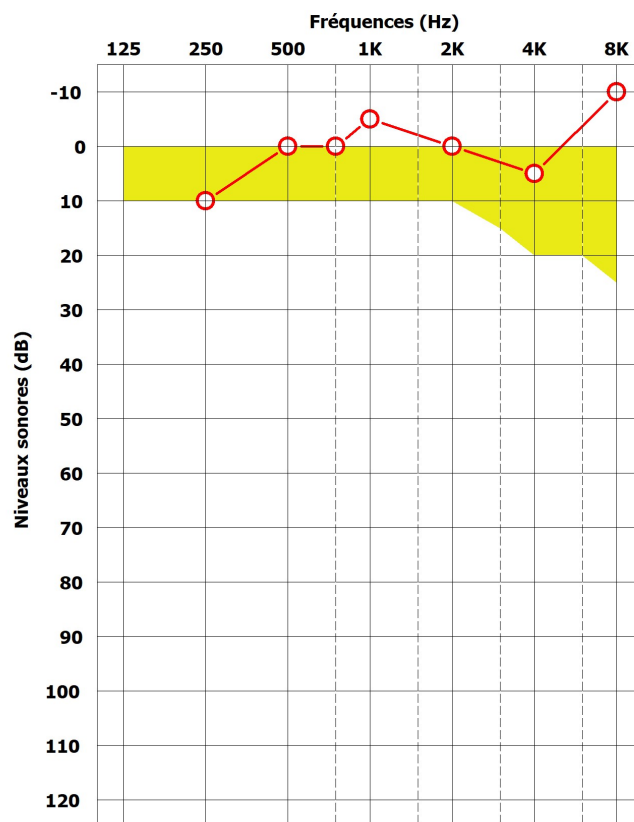

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	(80)	75	10		50		35		45
CA Droit		10	0	0	-5		0		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes