

MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 13:07:16

Durée: 4mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BAH OUMAR
Date de naissance	29/06/1978
Age	46
Société	SYLVATROP
ID	24081413040819586

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

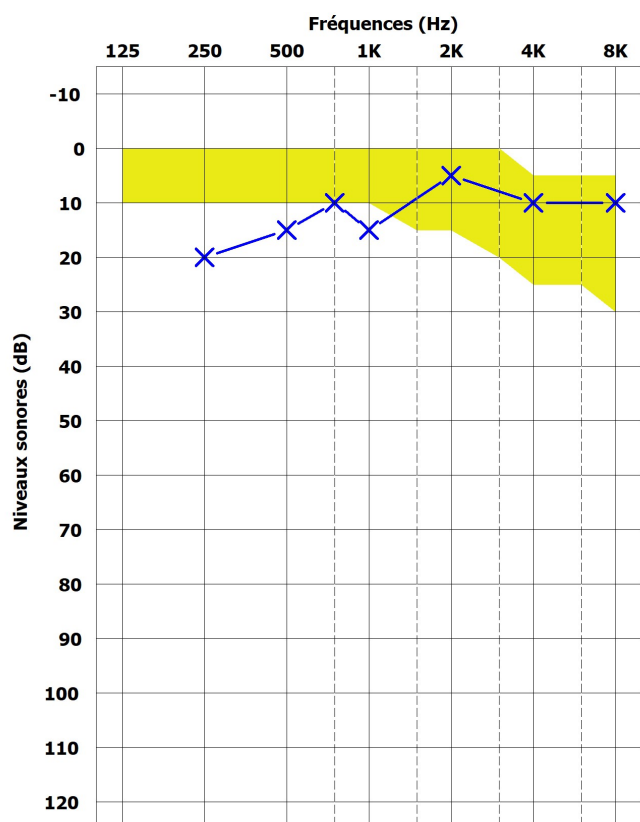

Oreille Gauche

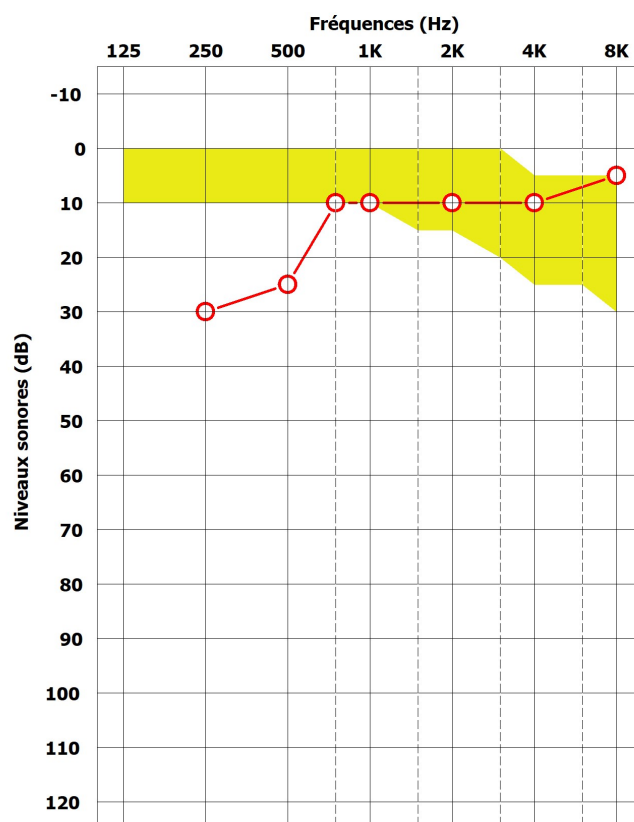

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	10	15		5		10		10
CA Droit		30	25	10	10		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes