


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:58:28

Durée: 5mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

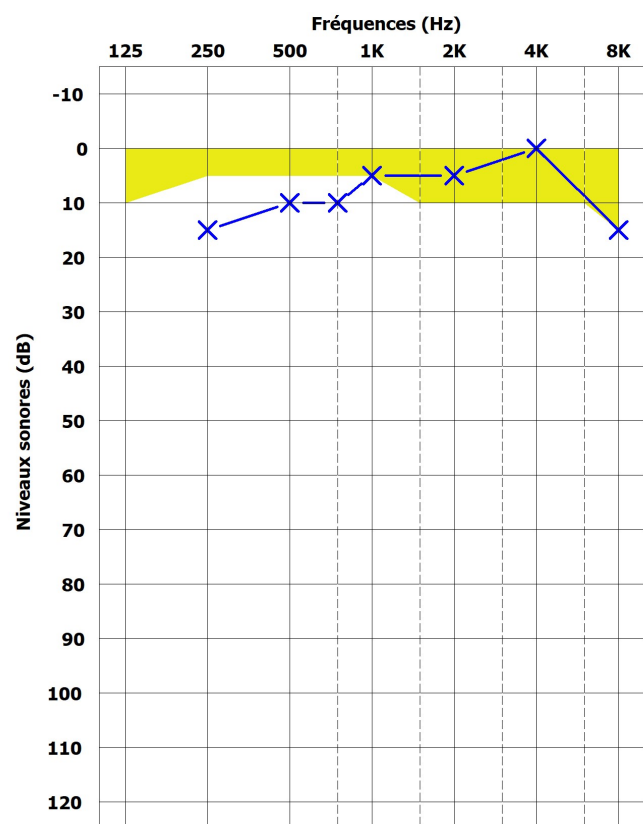

Oreille Gauche

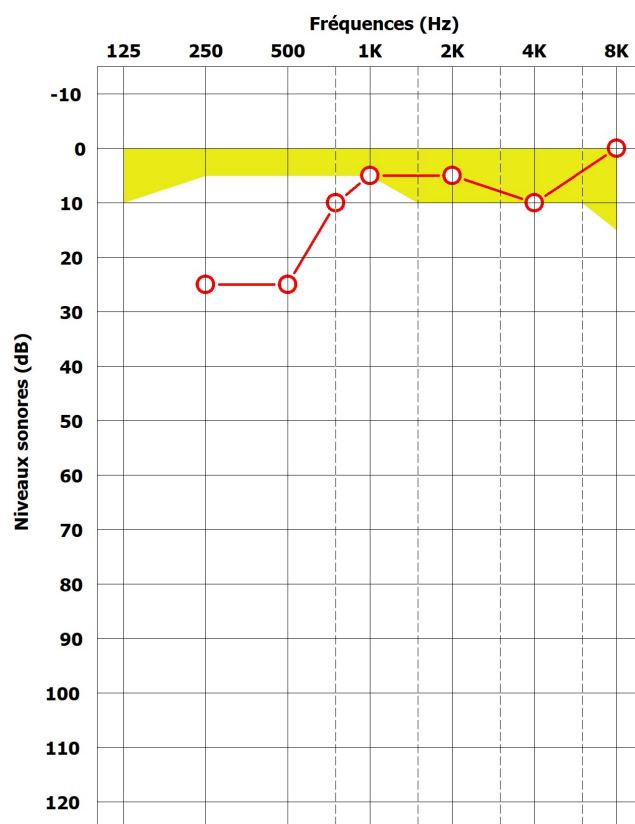

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	5		5		0		15
CA Droit		25	25	10	5		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	DORE MATHO
Date de naissance	23/05/1995
Age	29
Société	SYTLVATROP
ID	24081412544131711

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021