

MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 11:31:42

Durée: 4mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO Oumar
Date de naissance	25/09/1980
Age	44
Société	SYLVATROP
ID	24100811272353660

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

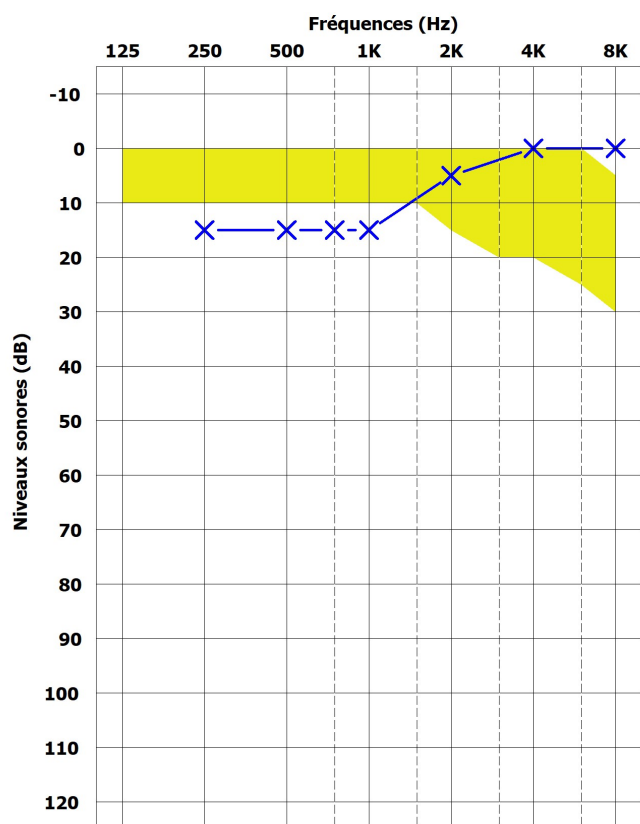

Oreille Gauche

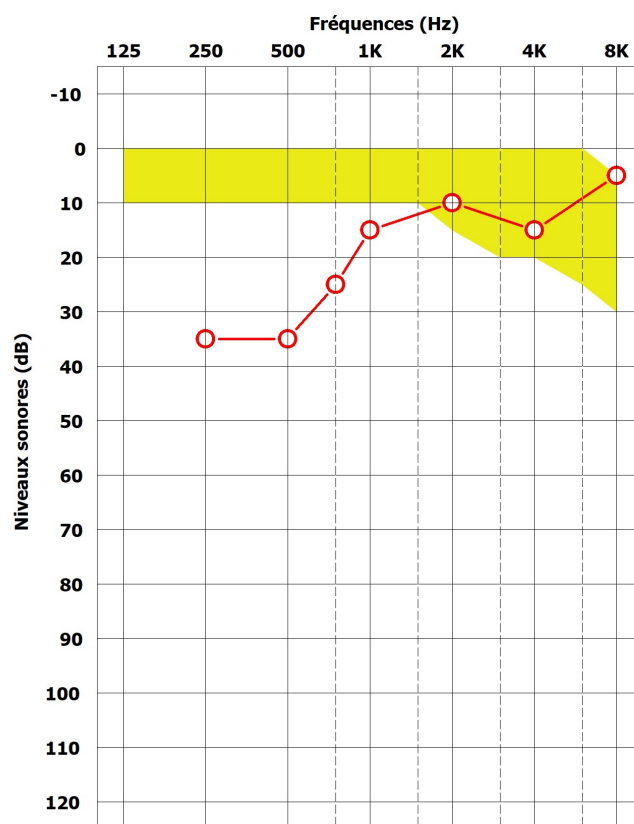

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		5		0		0
CA Droit		35	35	25	15		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes