


MEDVIE


Date du test: 09/10/2024 19:41:22

Durée: 3mn 44s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

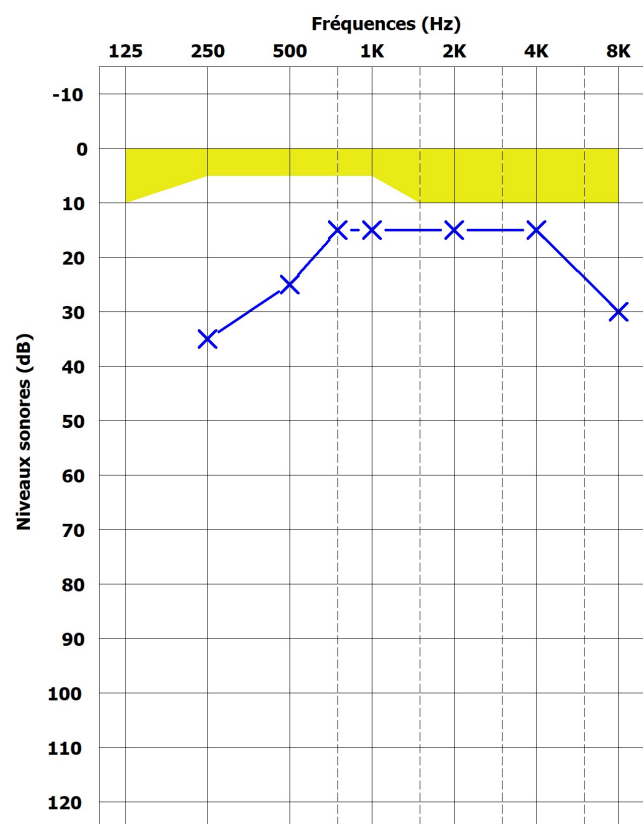

Oreille Gauche

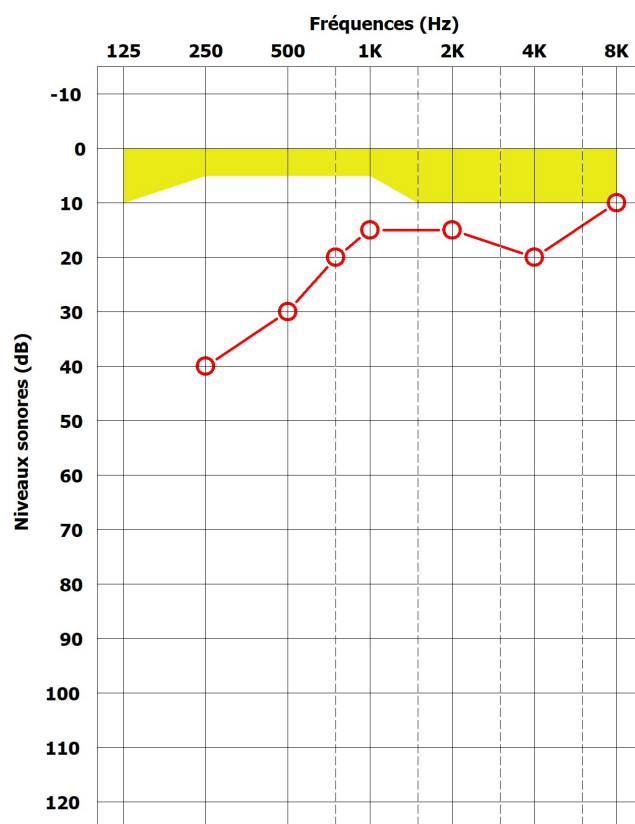

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 35  | 25  | 15  | 15 |     | 15 |    | 15 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 40  | 30  | 20  | 15 |     | 15 |    | 20 |    | 10 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 17,5 dB | --- |
| CA Droit  | 20,0 dB | --- |

Notes

Données Patient

**THIAM AMINATA**

Date de naissance

15/08/1996

Age

28

Société

SYLVATROP

ID

24100919373830756

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021