

MEDVIE


Date du test: 30/07/2025 11:24:02

Durée: 6mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ALHASSANE	
Date de naissance	12/07/2003
Age	22
Société	BETELCOM
ID	25073011203753613

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

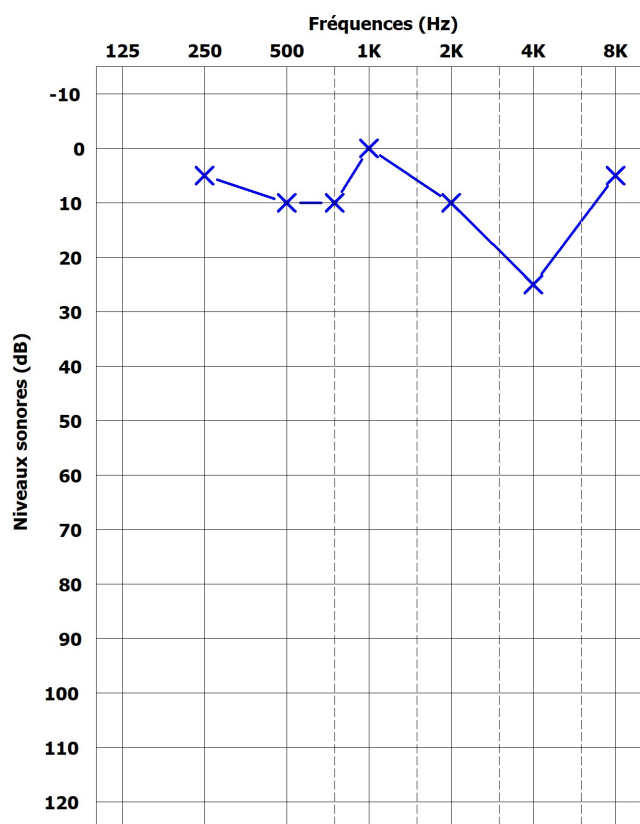

Oreille Gauche

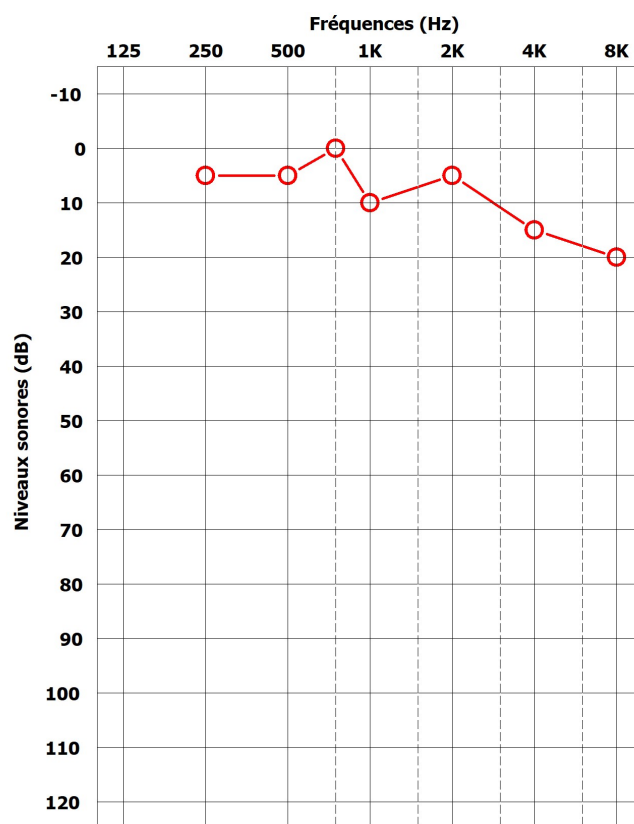

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	0		10		25		5
CA Droit		5	5	0	10		5		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes